

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。
- 2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
- 3、行业类别——按国标填写。
- 4、总投资——指项目投资总额。
- 5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
- 6、结论和建议——给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。
- 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
- 8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况.....	1
工程规模和内容.....	10
建设项目所在地自然环境简况.....	16
环境质量状况.....	19
评价适用标准.....	21
建设项目工程分析.....	26
项目主要污染物产生及预计排放情况	36
环境影响分析.....	37
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51
结论和要求.....	52

建设项目基本情况

项目名称	医药研发项目				
企业	南京福美瑞信科技有限公司				
法人代表	李其玲	联系人	汪宗华		
通讯地址	南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号D6栋809室				
联系电话	13952095963	传真	/	邮政编码	210046
建设地点	南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号D6栋809、810、811室				
立项审批部门	南京市栖霞区发展和改革局	备案证号	栖霞发改[2019]55号		
建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>		行业类别及代码	M7340 医学研究和试验发展	
占地面积(平方米)	/	建筑面积(平方米)	1929.49	绿化面积(平方米)	-
总投资(万元)	1000	其中环保投资(万元)	33	环保投资占总投资比例(%)	3.3
评价经费(万人民币)	-	预计投产日期	-		
原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 南京福美瑞信科技有限公司租用南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号D6栋809、810、811室进行医药研发项目的建设，项目内容主要包括：制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究等方面。 建设项目的原辅材料见表，主要设施设备见表。					
水及能源消耗量					
名称	消耗量	名称	消耗量		
新鲜水	1870t/a	电（度）	8万kwh/a		
废水（工业废水√、生活废水√）排水量及排放去向 企业的污水主要为生活污水和实验废水，废水排放量为1582t/a。生活污水经园区化粪池预处理，实验废水、洗衣废水经园区废水处理装置预处理。达到仙林污水处理厂二期接管标准后通过园区市政污水主管进入仙林污水处理厂，达标尾水经九乡河最终排入长江。					
放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无					

原辅材料及主要设备：

一、原辅材料

建设项目原辅材料消耗情况见表，主要原辅材料的理化性质见表。

表 1 建设项目主要原辅材料消耗一览表

序号	试剂名称	年用量 (kg)	来源	用途
1	微晶纤维素	100	外购	固体制剂 液体制剂
2	乳糖	100	外购	
3	甘露醇	100	外购	
4	淀粉	20	外购	
5	预胶化淀粉	20	外购	
6	交联羧甲基纤维素钠	10	外购	
7	交联聚维酮	10	外购	
8	羧甲基淀粉钠	10	外购	
9	聚维酮	10	外购	
10	羟丙纤维素	10	外购	
11	羟丙甲纤维素	5	外购	
12	硬脂酸镁	2	外购	
13	微粉硅胶	2	外购	
14	硬脂富马酸钠	2	外购	
15	胃溶型包衣预混剂	5	外购	
16	聚乙二醇 200	2	外购	
17	聚乙二醇 400	2	外购	
18	吐温 80	2	外购	
19	甲醇	500	外购	分析检测
20	乙腈	500	外购	
21	乙醇	100	外购	
22	正十二醇	0.5	外购	
23	吡啶	0.1	外购	
24	二乙胺	1	外购	
25	二乙二醇	0.5	外购	
27	叔丁醇	0.5	外购	
28	四氢呋喃	0.5	外购	
29	异辛醇	0.5	外购	
30	正庚烷	1	外购	
31	N-甲基吡咯烷酮	0.5	外购	
32	乙二醇	0.5	外购	
33	正辛烷	1	外购	
34	正己醇	0.5	外购	
35	异丙醇	4	外购	
36	丙三醇	2	外购	
37	氨水	5	外购	
38	三乙胺	0.5	外购	
39	N-甲基-2-吡咯烷酮	0.5	外购	
40	异辛烷	0.5	外购	

41	正丙醇	1	外购
42	苯胺	0.5	外购
43	甲酰胺	0.5	外购
44	三乙醇胺	0.2	外购
45	卡尔费休试液	3	外购
46	无羰基甲醇	10	外购
47	乙酸	2	外购
48	正丁醇	0.5	外购
49	正己烷	18	外购
50	二甲胺	0.1	外购
51	甲酸	0.5	外购
52	乙胺	0.5	外购
53	异丙醚	1	外购
54	N,N-二甲基甲酰胺	6	外购
55	二甲亚砷	1	外购
56	三氟乙酸	0.2	外购
57	8-羟基喹啉	0.01	外购
58	百里香酚蓝 IND	0.01	外购
59	苯甲酸	0.1	外购
60	草酸钠 PT	0.1	外购
61	碘化钠	0.5	外购
62	碘酸钾 PT	0.1	外购
63	靛蓝胭脂红 BS	0.1	外购
64	对二甲氨基苯甲醛 AR	0.3	外购
65	二甲酚橙四钠盐 AR	0.01	外购
66	二甲酚橙	0.1	外购
67	酚酞 IND	0.1	外购
68	钙紫红素	0.2	外购
69	高碘酸钾	0.1	外购
70	高碘酸钠	0.1	外购
71	结晶紫 AR	0.05	外购
72	甲酚红	0.01	外购
73	甲基橙 IND	0.01	外购
74	甲基红 IND	0.01	外购
75	抗坏血酸 AR	0.2	外购
76	L-苯丙氨酸	0.1	外购
77	邻苯二甲酸氢钾 PT	0.04	外购
78	磷酸二氢钾	10	外购
79	磷酸钠,十二水	2	外购
80	磷酸氢二钠.二水 HPLC	2	外购
81	硫代乙酰胺 AR	0.3	外购
82	硫酸锌 SP	0.01	外购
83	六水合氯化铁	0.5	外购
84	氯化钾	5	外购
85	氯化钠	5	外购
86	氢氧化钾	5	外购

87	氢氧化钠	5	外购
88	三水合乙酸钠	20	外购
89	4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚	0.02	外购
90	碳酸钙	2	外购
91	碳酸钾 SP	5	外购
92	无水磷酸二氢钠 HPLC	20	外购
93	无水碳酸钠 PT	10	外购
94	锌粉	0.2	外购
95	溴百里香酚蓝	0.3	外购
96	溴化钾 SP	0.5	外购
97	溴甲酚绿 IND	0.05	外购
98	茚三酮 AR	0.05	外购
99	硫酸钾 PT	1	外购

表2 建设项目主要原辅材料理化性质

序号	名称	分子式	理化性质	燃烧爆炸性	毒理毒性
1	甲醇	CH ₄ O	无色澄清液体，有刺激性气味。易挥发，分子量 32.04，闪点 11℃；沸点 64.8℃；相对密度（水=1）0.79；饱和蒸汽压 13.33kPa（21℃），溶于水，可混溶于醇、醚等大多数有机溶剂。	易燃	低毒类 LD ₅₀ : 5628mg/kg（大鼠经口）； 15800mg/kg（兔经口）； LC ₅₀ : 83776mg/m ³
2	乙腈	C ₂ H ₃ N	无色液体，有刺激性气味，分子量为 41.05。熔点-45.7℃；沸点 80-82℃；闪点 6℃，相对密度（水=1）0.79；与水混溶，溶于醇等大多数有机溶剂。	易燃	中毒类 LD ₅₀ : 2730mg/kg（大鼠经口）； LC ₅₀ : 12663mg/m ³
3	乙醇	C ₂ H ₆ O	无色透明液体（纯酒精），有特殊香味，易挥发。能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他大多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。乙醇液体密度是 0.789g/cm ³ ，乙醇气体密度为 1.59kg/m ³ ，沸点是 78.4℃，熔点是-114.3℃，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，与水以任意比互溶	易燃	低毒类 LD ₅₀ : 7060mg/kg（大鼠经口）； 7340mg/kg（兔经皮）； LC ₅₀ : 37620 mg/m ³ ，10 小时（大鼠吸入）
4	十二醇	C ₁₂ H ₂₆ O	白色固体或无色液体，具花香味。分子量为 186.38。熔点 24℃；沸点 255-259℃；闪点 126.7℃，相对密度（水=1）0.82；不溶于水、甘油，溶于丙二醇、乙醇、苯、氯仿、乙醚。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 12800 mg/kg(大鼠经口)
5	吡啶	C ₅ H ₅ N	无色或微黄色液体，有恶臭。分子量为 79.10。熔点-42℃；沸点 115.3℃；闪点 17℃，相对密度（水=1）0.98；溶于水、醇、醚等大多数有机溶剂。	易燃	低毒类 LD ₅₀ : 1580 mg/kg(大鼠经口)； 1121 mg/kg(兔经皮)

6	二乙胺	C ₄ H ₁₁ N	无色液体，有氨臭。分子量为 73.14。熔点 -38.9℃；沸点 55.5℃；闪点 -23℃，相对密度（水=1）0.71；溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。	极易燃	低毒类 LD ₅₀ : 540 mg/kg(大鼠经口)；820 mg/kg(兔经皮) LC ₅₀ : 11960mg/m ³ , 4 小时(大鼠吸入)
7	乙二醇	C ₂ H ₄ O ₂	无色、无臭、开始味甜回味苦的粘稠液体，具有吸湿性。分子量为 106.12。熔点 -8℃；沸点 245.8℃；闪点 124℃，相对密度（水=1）1.12；与水混溶，不溶于苯、甲苯、四氯化碳。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 16600 mg/kg(大鼠经口)；26500 mg/kg(小鼠经口)；11900 mg/kg(兔经皮)
8	叔丁醇	C ₄ H ₁₀ O	无色透明液体或无色结晶，易过冷，在少量水存在时则为液体。有类似樟脑的气味，有吸湿性。能与水、醇、酯、醚、烃、等多种有机溶剂混溶。沸点 82.42℃，熔点 25.7℃。	易燃	低毒类 3500mg/kg(大鼠经口)。
9	四氢呋喃	C ₄ H ₈ O	无色透明液体。有乙醚气味，分子量 72.1，闪点 -17℃；沸点 66℃；饱和蒸汽压 18.9kPa（20℃）。室温时与水完全混溶	易燃	低毒类 大鼠经口 LD ₅₀ :1650mg/kg；吸入 LC ₅₀ :21000ppm /3H。
10	异辛醇	C ₈ H ₁₈ O	澄清的液体。分子量为 130.23。熔点 -76℃；沸点 185-189℃；闪点 77℃，相对密度（水=1）0.83。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 2049 mg/kg(大鼠经口)；1970 ml/kg(兔经皮)
11	正庚烷	C ₇ H ₁₆	无色易挥发液体，熔点(℃)：-90.5，沸点(℃)：98.5，相对密度 0.68，不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿对水生生物有极高毒性，可能对水体环境产生长期不良影响。	易燃	中等毒性 LD ₅₀ : 222 mg/kg(小鼠静脉) LC ₅₀ : 75000mg/m ³ , 2 小时(小鼠吸入)
12	N-甲基吡咯烷酮	C ₅ H ₉ NO	无色透明油状液体，微有胺的气味。分子量为 99.13。熔点 -24.4℃；沸点 204℃；闪点 95℃。易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、氯仿和苯，能溶解大多数有机与无机化合物、极性气体、天然及合成高分子化合物。	可燃	低毒类 大鼠口服 LD ₅₀ : 3914mg/kg, LC ₅₀ : 5130mg/kg;
13	乙二醇	C ₂ H ₆ O ₂	无色、无臭、有甜味、粘稠液体。分子量为 62.07。熔点 -13.2℃；沸点 197.5℃；闪点 110℃。与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 8000~15300 mg/kg(小鼠经口)；5900~13400 mg/kg(大鼠经口)
14	正辛烷	C ₈ H ₁₈	无色透明液体。分子量为 114.23。熔点 -13.2℃；沸点 125.8℃；闪点 12℃。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。	易燃	中等毒性 LC ₅₀ : 118g/m ³ (大鼠吸入, 4h)

15	正己醇	C ₆ H ₁₄ O	无色液体。分子量为 102.18。熔点-44.6℃；沸点 157.2℃；闪点 60℃。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。	易燃	低毒类 LD ₅₀ : 720 mg/kg(大鼠经口)；3100 mg/kg(兔经皮)
16	异丙醇	C ₃ H ₈ O	无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，分子量为 60.06。熔点-87.9℃；沸点 82.45℃。	可燃	低毒类 口服-大鼠 LD ₅₀ : 5840 毫克/公斤； 口服-小鼠 LC ₅₀ : 3600 毫克/公斤
17	丙三醇	C ₃ H ₈ O ₃	无色粘稠液体，无气味，有暖甜味，能吸潮。分子量为 92.09。熔点 20℃；沸点 182℃；闪点 160℃。可混溶于醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、油类。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 12600 mg/kg(大鼠经口)
18	氨水	NH ₄ OH	无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。分子量为 35.05。相对密度（水）：0.91。溶于水、醇。易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。	不燃	中等毒性 LD ₅₀ : 350mg/kg(大鼠经口)
19	三乙胺	C ₆ H ₁₅ N	具有强烈的氨臭的无色透明液体，在空气中微发烟。微溶于水，可溶于乙醇、乙醚。水溶液呈弱碱性。熔点：-114.8℃，相对密度（水=1）：0.726，沸点：89.5℃	易燃	中等毒性 LD ₅₀ : 460mg/kg(大鼠经口)；LD ₅₀ : 546mg/kg(小鼠经口)
20	正丙醇	C ₃ H ₈ O	无色液体。分子量为 60.1。熔点-127℃；沸点 97.1℃；闪点 15℃。与水混溶，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。	易燃	低毒类 LD ₅₀ : 1870 mg/kg(大鼠经口)； 5040 mg/kg(兔经皮) LC ₅₀ : 48000 mg/m ³ (小鼠吸入)
21	苯胺	C ₆ H ₇ N	无色或微黄色油状液体，有强烈气味。分子量为 93.12。熔点-6.2℃；沸点 184.4℃；闪点 70℃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。	可燃	中等毒性 LD ₅₀ : 442 mg/kg(大鼠经口)； LC ₅₀ : 665mg/m ³ , 7 小时(小鼠吸入)
22	甲酰胺	CH ₃ NO	无色油状液体，有吸湿性。分子量为 45.04。熔点 2.6℃；沸点 210℃；闪点 154℃。与水混溶，溶于甲醇、乙醇，不溶于乙醚、烃类。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 7500 mg/kg(大鼠经口)； 4600 mg/kg(小鼠腹腔)
23	三乙醇胺	C ₆ H ₁₅ NO ₃	无色油状液体或白色固体，稍有氨的气味。分子量为 149.19。熔点 20℃；沸点 335℃；闪点 185℃。易溶于水。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 5000~9000 mg/kg(大鼠经口)
24	乙酸	C ₂ H ₄ O ₂	纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为 16.7℃，凝固后为无色晶体。分子量为 60.05。熔点 16.6℃；沸点 117.9℃；易溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳。	-	-

25	正丁醇	C ₄ H ₁₀ O	无色透明液体，具有特殊气味。分子量为74.12。熔点-88.9℃；沸点 117.5℃；闪点 35℃。微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。	易燃	低毒类：LD ₅₀ : 4360 mg/kg(大鼠经口)； LC ₅₀ : 24240mg/m ³ , 4 小时(大鼠吸入)
26	正己烷	C ₆ H ₁₄	有微弱的特殊气味的无色液体，不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮。熔点-95.3℃ 沸点 68.74℃，密度 0.692 g/mL。主要用作溶剂，用于配制粘胶以粘合。	易燃	低毒类 LD ₅₀ : 28710mg/kg (大鼠经口)；
27	二甲胺	C ₂ H ₇ N	无色气体，高浓度的带有氨味，低浓度的有烂鱼味。分子量为 45.02。熔点-92.2℃；沸点 6.9℃；闪点-17.8℃。易溶于水，溶于乙醇、乙醚。	易燃	低毒类 LC ₅₀ : 8354mg/m ³ , 6 小时(大鼠吸入)
28	甲酸	CH ₂ O ₂	无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。分子量为 46.03。熔点 8.2℃；沸点 100.8℃；闪点 68.9℃。与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 1100 mg/kg(大鼠经口) LC ₅₀ : 15000 mg/m ³ , 15 分钟(大鼠吸入)
29	乙胺	C ₂ H ₇ N	无色、有强烈氨味的液体或气体。分子量为 45.08。熔点-80.9℃；沸点 16.6℃；闪点-17.8℃。溶于水、乙醇、乙醚等。	易燃	中等毒性 LD ₅₀ : 400 mg/kg(大鼠经口)；390 mg/kg(兔经皮)
30	异丙醚	C ₆ H ₁₄ O	无色液体，有类似乙醚的气味。分子量为 102.18。熔点-85.9℃；沸点 68.5℃；闪点-12℃。不溶于水，可混溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。	极易燃	低毒类 LD ₅₀ : 8470 mg/kg(大鼠经口)； LC ₅₀ : 162000 mg/m ³ (大鼠吸入)
31	DMF (N,N-二甲基甲酰胺)	C ₃ H ₇ NO	无色、淡的氨气味的液体。相对密度 0.9445 (25℃)。熔点-61℃。沸点 152.8℃。闪点 57.78℃。蒸气密度 2.51。蒸气压 0.49kpa (3.7mmHg25℃)。自燃点 445℃。与水通常有机溶剂混溶,与石油醚混合分层。	易燃	中等毒性 LD ₅₀ : 350mg/kg (大鼠经口)
32	二甲亚砜	C ₂ H ₆ OS	无色无臭液体。分子量为 78.13。熔点 18.45℃；沸点 189℃；闪点 95℃。溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 9700~28300 mg/kg(大鼠经口)
33	三氟乙酸	C ₂ HF ₃ O ₂	无色有强烈刺激气味的发烟液体。分子量为 114.03。熔点-15.2℃；沸点 72.4℃。易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯。	不燃	中等毒性 LD ₅₀ : 200 mg/kg(大鼠经口) LC ₅₀ : 1000 mg/m ³ (大鼠吸入)
34	8-羟基喹啉	C ₉ H ₇ NO	白色或淡黄色结晶或结晶性粉末。分子量为 145.16。熔点 75~76℃；沸点 267℃。不溶于水、乙醚，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯、无机酸。	可燃	低毒类 大鼠经口 LD ₅₀ : 1200 mg/kg； 大鼠 LC ₅₀ : 1210 mg/m ³ /6H
35	百里香酚蓝	C ₂₇ H ₃₀ O ₅ S	暗蓝、绿或红紫色结晶性粉末，有异臭。分子量为 466.59。熔点 200-220℃。溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。	可燃	/

36	苯甲酸	C ₇ H ₆ O ₂	鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛的臭味。分子量为 122.13。熔点 121.7℃；沸点 249.2℃；闪点 121℃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、二硫化碳、四氯化碳。	可燃	低毒类 LD ₅₀ : 2530 mg/kg(大鼠经口)
37	草酸钠	C ₂ O ₄ Na ₂	白色结晶性粉末。无气味。有吸湿性。分子量为 134。熔点 250-257℃（分解）。溶于水，不溶于乙醇。	不燃	中等毒性 小鼠腹腔 LC ₅₀ : 155 mg/kg
38	对二甲氨基苯甲醛	C ₉ H ₁₁ NO	灰白色的结晶粉末。分子量为 149.18。熔点 73-75℃；沸点 176-177℃。微溶于水，溶于醇、醚、氯仿、酸、多数有机溶剂。	可燃	/
39	二甲酚橙	C ₃₁ H ₃₂ N ₂ O ₁₃ S	红棕色粉末。分子量为 673。熔点 72-76℃。易溶于水，不溶于无水醇。	可燃	微毒
40	高碘酸钾	KIO ₄	无色结晶或白色粉末。分子量为 230。熔点 582℃（爆炸）。微溶于冷水，溶于热水。	氧化性固体	/
41	高碘酸钠	NaIO ₄	无色结晶或白色晶状粉末。分子量为 213.89。熔点 300℃（分解）。易溶于水、乙酸、盐酸、硫酸、硝酸，不溶于乙醇。。	氧化性固体	中等毒性 LD ₅₀ : 58 mg/kg(小鼠腹腔)
42	L-苯丙氨酸	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂	白色粉末。分子量为 179.22。熔点 270-275℃。	/	微毒
43	氢氧化钾	KOH	白色粉末或片状固体。熔点 380℃，沸点 1324℃，相对密度 2.04g/cm ³ 。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。	-	中毒 大鼠经口 LD ₅₀ : 273mg/kg
44	氢氧化钠	NaOH	俗称烧碱、火碱、苛性钠，具有高腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气。密度 2.130g/cm ³ 。熔点 318.4℃。沸点 1390℃	不燃	-
45	锌粉	Zn	浅灰色的细小粉末。分子量：65.38，熔点：419.6℃。溶于酸、碱。	遇湿易燃	-

二、主要设备

建设项目主要研发设备见表 3。

表 3 建设项目主要研发设备一览表

序号	新增资产名称	规格	数量	品牌	类别
1	气流粉碎机	JGM-H50	1	上海华砺新材料科技有限公司	新购
2	机械粉碎机	FW100	1	天津市泰斯特仪器有限公司	新购
3	湿法制粒机	G10	1	深圳市信宜特科技有限公司	新购
4	干法制粒机	GL2-25	1	深圳市信宜特科技有限公司	新购
5	流化床	Glat-mini	1	德国格拉特有限公司	新购

6	三维混合机	SH-5/10	1	张家港开创机械制造有限公司	新购
7	旋转压片机	ZP10A	2	北京新龙立科技有限公司	新购
8	单冲压片机	DP30A	2	北京新龙立科技有限公司	新购
9	高效包衣机	BGB-0.25/1/3/5	1	深圳市信宜特科技有限公司	新购
10	溶出试验仪	DPX8-3\TX8	4	德国 Riggtek 公司	新购
11	快速水分测定仪	DHS-16	1	上海菁海仪器有限公司	新购
12	硬度仪	YPD-200C	2	上海黄海药检仪器有限公司	新购
13	崩解仪	LB-2D	1	上海黄海药检仪器有限公司	新购
14	脆碎度检测仪	CJY300D	1	上海黄海药检仪器有限公司	新购
15	恒温振荡器	HT-211B	2	上海沉汇仪器有限公司	新购
16	粒径测定仪	Mastersize3000	1	英国马尔文仪器有限公司	新购
17	粉体特性测定仪	BT-1000	1	丹东百特仪器有限公司	新购
18	高效液相色谱仪	LC-20A	8	日本岛津公司	新购
19	气相色谱仪	GC-2010plus	1	日本岛津公司	新购
20	紫外可见分光光度计	UV-2600	2	日本岛津公司	新购
21	稳定性试验箱	LT-DSX400	5	上海立德泰勉	新购
22	卡氏水分仪	ZKF-1A	1	瑞士万通	新购
23	离心机	TDL80-2B	2	上海安亭科学仪器厂制造	新购
24	超声仪	KH-500B	3	昆山禾创超声仪器有限公司	新购
25	鼓风干燥箱	DHG-9030A	6	上海一恒仪器设备有限公司	新购
26	真空干燥箱	DZF-6050	2	上海一凯仪器设备有限公司	新购
27	分析天平	BT125D	8	梅特勒-托利多	新购
28	pH 计	Mettler-Toledo 320	2	梅特勒-托利多	新购
29	超纯水仪	UPR-11-20L	2	四川优普超纯科技有限公司	新购
30	光照箱	LT-DSX400S G	1	上海一恒科学仪器有限公司	新购

工程规模和内容

工程内容及规模：

一、项目由来

南京福美瑞信科技有限公司位于南京市栖霞区，承租江苏生命科技创新园 D6 栋 809、810、811 室，面积共 1929.49 平方米，进行医药研发项目的开展。项目投资 1000 万元，固定资产 500 万元。项目内容主要包括：制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究等方面。项目仅进行医药研发，不涉及生产，药物研发量约为 400kg/a，试验样品在研究完成后将按固废报废处理，不能上市销售。目前该项目已在栖霞区发改局备案（备案号：栖发改备[2019]55 号）。

项目租用的江苏生命科技创新园 D6 栋 809、810、811 室为通过环评验收的毛坯房，不存在环评遗留问题，企业租用该场地后将依据研究需要对其进行重新装修，作为医药研发及办公用房。

根据国家相关规定，南京福美瑞信科技有限公司委托南京亘屹环保科技有限公司承担该公司“南京福美瑞信科技有限公司医药研发项目”的环评工作，编写环境影响报告表。环评单位在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周边进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该项目的建设特点，编制了此环境影响报告表，上报南京市栖霞区环境保护局审批。项目初筛情况见表 4。

表 4 项目初筛情况一览表

序号	初筛内容		相关情况	分析结论
1	选址选线		位于江苏生命科技创新园，符合国家和地方产业政策和用地要求；符合《江苏生命科技创新园项目环境影响报告书》及其批复要求。	符合选址选线要求
2	规模		租用园区现有房屋 D6 栋 809、810、811 室，建筑总面积 1929.49m ² ，药物研发量约为 400kg/a。	为医药研发，不涉及生产，符合要求。
3	性质		新建	/
4	产业政策		建设项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中鼓励类：十三、医药 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中鼓励类：十一、医药 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产。因此建设项目符合相关国家和地方产业政策。	符合产业政策要求
5	“三线一单”	生态保护红线	距离本项目最近的生态红线保护区为南京栖霞山国家森林公园，约 160m。	不在生态保护红线范围内，符合要求
6		环境质量底线	项目所在区域的环境空气、声环境、地表水环境质量均较好。	符合要求

7		资源利用上线	本项目仅消耗少量的电力、水资源。	符合要求
8		环境准入清单	本项目符合江苏生命科技创新园区准入要求。不属于《南京市建设项目环境准入暂行规定》宁政发〔2015〕251号中禁止准入类项目,为允许建设项目;不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录(2018年版)》宁委办发〔2018〕57号中栖霞区制造业新增项目禁止和限制类项目。	符合要求
9	与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》相符性		本项目实验废气和废水产生量较小,经收集处理后达标排放,符合“两减六治三提升”专项行动。	符合要求
10	与省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知(苏政发〔2018〕122号)、《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》相符性		不属于蓝天保卫战实施方案中严控的“两高”行业和严禁新增的行业,不属于污染攻坚战产能淘汰的行业。	符合要求

二、项目概况

项目名称：南京福美瑞信科技有限公司医药研发项目

建设地点：江苏生命科技创新园 D6 栋 809、810、811 室（详见附图 1-建设项目地理位置图）

企业名称：南京福美瑞信科技有限公司

项目性质：新建

建设规模：总建筑面积 1929.49m²（租用）

投资金额：1000 万元

职工人数：50 人

工作时间：年工作时间为 240d，实验室年工作数为 1920h（按 8h/d 计）

行业类别及代码：M7340 医学研究和试验发展

三、产业政策相符性及总体规划相容性

该项目主要进行制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性

研究等方面的医药研发，属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类：十三、医药 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类：十一、医药 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产。因此该项目符合相关国家和地方产业政策。

该项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目，因此该项目符合相关用地规划。

四、与区域规划的相符性

该项目建设地点位于江苏生命科技创新园 D6 栋 809、810、811 室。该楼为江苏生命科技创新园设置的生物医药企业研发楼，该楼东侧为园区医药研发楼 C6，距离 30m；西侧为园区医药研发楼 D7，距离 35m；南侧为园区医药研发楼 D1、D2、D3 栋，最近距离为 67m；北侧距离宁镇公路 110m。

根据《南京市城市总体规划》（2011-2030），仙林新市区白象片区为仙林新市区中重点发展地区。集中安排国际高教园区、科研机构和产业用地，以“产、学、研”同步发展为特色，力争形成南京市重要的高新技术产业园，该项目位于仙林新市区白象片区，主要专注于医药研究开发，符合《南京市城市总体规划》（2011-2030），该项目所在区域用地规划见附图 4。

江苏生命科技创新园产业定位以生物医药产业研发为主（不涉及生产）：包括生物技术产业研发、医药产业研发，并在此基础上发展总部经济，重点发展医药企业总部基地产业、生物医药研发孵化中心产业、生物医药服务外包中心产业等。该建设项目就是医药研发项目，不涉及生产，符合园区规划。

该项目营运期在顶楼废气排放口设置活性炭吸附装置，废气经活性炭吸附后达标排放。企业的实验废水经园区配套的废水处理装置预处理，生活污水经园区配套的化粪池预处理，经预处理的废水达到仙林污水厂二期接管标准后排入园区南侧市政污水主管井，然后排入仙林污水处理厂处理，废水经南京仙林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后由九乡河排入长江。固废经分类收集后妥善处理，不外排。

该项目主要进行制剂的处方开发、制备工艺开发、分析检测方法开发以及样品稳定

性研究等方面的医药研发，建设项目符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《南京市生态红线区域保护规划》，本项目不位于生态红线一级、二级管控区内。项目距最近的生态红线保护区栖霞山国家森林公园 160m，距龙潭饮用水水源保护区 3700m，项目建设对栖霞山国家森林公园、龙潭饮用水水源保护区影响小。本项目与南京市生态红线区域位置关系图见附图 5。

五、项目建设内容及总图布置

本次拟建的“医药研发项目”，研发内容为制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法开发以及样品稳定性研究。本项目属于医药研发项目，所用原辅材料均不涉及重金属，不属于涉重和化工项目。企业研发目的是为了申报国家食品药品监督管理局的试验新药临床研究许可。本项目研发的样品不外售，研发均只涉及小试，项目所有研发药物年总研发量不超过 400kg，不设反应釜，也不属于化工项目，研究完成后所有试验样品将按固废报废处理。

企业租用的实验办公用房（D6 栋 809、810、811 室）建筑面积为 1929.49m²，可分为研发实验区、物料储存区及办公区等三个核心功能区。其中，研发实验区又可分为：实验室、固体制剂室、液体制剂室、液相室等；物料储存区包括危化品库、试剂库、一般仓库和危废间。建设项目平面布置示意图见附图 3。

建设项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等组成情况见表 5。

表 5 建设项目组成一览表

类别	名称	规模	备注
主体工程	研发实验区	实验室、固体制剂室、液体制剂室、液相室等，在实验室内配套相应的实验设备。	约 700 m ² ，设 7 个通风橱
辅助工程	办公区	用于非实验类日常办公、会议、培训等	约 800m ²
储运工程	物料储存区	用于储存各类试剂、危化品、一般物资	约 60m ²
	危废间	用于临时贮存危险废物	约 10m ²
公用工程	给水	新鲜用水 1870t/a；纯水制备系统 1 套	用水由园区给水管网提供；纯水制备系统采用二级反渗透+EDI 制水机组制备，企业外购。
	排水	排水量约 1582t/a	依托园区现有废水处理装置及污水管网
	消防	依托园区现有消防管网及消防水池 138m ³	依托园区现有
	供配电	用电量约 8 万 kwh/a	园区电网提供

环保工程	废气处理	设 7 个通风橱，实验废气经过通风橱收集后与收集至通风橱管道的危险废物贮存区废气一起通过园区内置废气管道引至楼顶活性炭吸附装置处理达标排放，排口设于楼顶，高约 50 米。	新建 1 个废气排口
	废水处理	生活污水依托园区现有化粪池处理，实验废水依托园区废水预处理装置处理，处理达到接管标准后进入仙林污水处理厂。	依托园区现有
	固体废物	生活垃圾：由园区环卫部门统一处理；危险废物：分类收集临时储存于危废间内，委托有危险废物处置资质的单位上门收集处置。	无害化
	噪声	隔声、减震	达标排放

六、公用辅助工程

项目建成后依托的江苏生命科技创新园现有公用工程能满足需求。

1、给排水

项目用水由园区给水管网提供。

项目购买 1 套纯水制备系统为实验室提供纯化水，采用两级反渗透工艺制备，制水率 50%，具体工艺为：进水→原水箱→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→一级反渗透→二级反渗透→中间水箱→EDI 装置→无菌水箱→紫外线杀菌器→微孔过滤→出水。

项目排水依托江苏生命科技创新园的排水系统，实行雨、污分流制。雨水经管网收集后排入园区南侧河道。企业的实验废水经过园区生化处理装置预处理，生活污水经过园区化粪池预处理，经预处理后的废水达到仙林污水厂二期接管标准后排入园区南侧市政污水主管井，然后排入仙林污水处理厂处理，处理达标后的尾水经九乡河最终排入长江。南京市排水管道接管审批意见见附件 2。

2、供电

该项目营运期主要利用的能源为清洁能源电能，用电量约 8 万 kWh/a，区域供电能力可满足需求。

3、消防

(1) 按照《建设设计防火规范》的规定：建筑物的耐火等级不应低于二级，为此，该项目建筑物耐火等级确定为二级。

(2) 该项目内设置消防报警系统，避免造成财产损失与人员伤亡。在条件允许时，系统可采用集中管理，总线结构布局，探测器、自动与手动相结合的控制方式，使系统

报警更加准确。

(3) 设立消防通道、购置消防设备、制定消防安全制度、增强员工的消防安全意识，将火灾的隐患消灭在萌芽状态。

4、物料运输、贮存

企业为实验室配置的通用试剂等原辅材料均使用汽车运输，药品存放于专用橱柜或冰箱内。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

（1）地理位置

建设项目位于江苏生命科技创新园内，园区位于仙林大学城高校科技产业园区中312国道以南、九乡河以东，毗邻南京大学仙林国际化校区，东临元化路（原西山路），西侧为西山变电站，南临纬地路（原万象路），北临规划中的齐民西路。建设项目地理位置见附图1、周边环境概况见附图2。

（2）气候与气象

本地区属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10~3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4~9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降雨丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222~224天，年日照时数1987~2170小时。

（3）地质地形地貌

栖霞区地质构造属宁镇褶皱带，地势起伏大，地貌类型多，低山、丘陵、岗地、平原、洲地交错分布。土壤类型大致可分低山丘陵区、岗地区和平原（含洲地）区三类。栖霞区地形大体南高北低，南部丘陵、岗地连绵起伏，海拔多在50~300米之间，北部沿江平原及江中洲地，地势低平，海拔在10米以下，汛期常受洪水威胁，是南京市重点防洪区之一。

（4）水系与水文

① 长江南京江段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计，历年最高水位10.2米，最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，枯水期最大潮差别1.56米，多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，最大流量为92600m³/s，多年平均流量为28600m³/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。

② 九乡河古称“江乘浦”，源头在江宁县汤山镇琐石村、青龙山一带，至栖霞镇石埠桥村汇入长江。又称“琐石溪”、运粮河。据《江宁县志》载，因其旧时流经琐石、

东流、西流、其林（麒麟）、仙林、长林、衡阳、栖霞、石埠 9 乡，而得名。九乡河全长 23 公里，流域面积 145 平方公里，流经江宁区其林镇、栖霞区栖霞镇后注入长江，特点是源短流急，降雨时上游山区洪水很快下泻到中下游，洪水在入江口段受河道阻水建筑物影响，不能顺畅入江，导致河道水位上涨，威胁两岸安全。九乡河下游在 1973 年至 1974 年春曾以 10 年一遇的标准进行过疏浚整治，在麒麟镇段设计流量为 $160\text{m}^3/\text{s}$ ，在栖霞镇段设计流量为 $200\text{m}^3/\text{s}$ ，但由于长江入口段的沿河建有小型建筑物以蓄水灌溉，阻水状况并未有改变。

九乡河大学城段河道长约 3.4 千米，堤坝顶高 12-14m，河底高程 6.0-8.0m，河底宽 20m，局部较宽或较窄，边坡 1: 2.0，跨河有四座桥，其中一座已毁。但在河道中阻水明显，有一滚水坝拦河蓄水，上游蓄水 10m。

（5）植被和生物多样性

该地区地处北亚热带，气候湿润，雨水充沛，地形复杂，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰富。植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿针叶为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，有茶、桑、梨等。该地区的植物共有 180 科 900 多种，可分为木、竹、花、疏、草等五大类，其中比较平分秋色的有杜仲等植物。

该地区主要的植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等）、浮叶植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水共生等）。河渠池塘多生长狐尾藻、苦菜等沉水水生植物，浅水处主要有浮萍、莲子等浮水、挺水水生植物。

主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟形似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新镖水蚤等。

该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河蚬和棱螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

江苏生命科技创新园：

建设项目位于江苏生命科技创新园内，江苏生命科技创新园由栖霞区委、区政府和仙林大学城管委会于 2009 年初共同出资创建，占地 675 亩，总建筑面积约 70 万平方米。计划利用 5 年的时间投资 30 亿元，建设成为生态化科技型生物医药高端产业特色的生物医药集聚区。江苏生命科技创新园已经实现开工建设 60 万平方米单体建筑，封顶达 20 万平方米，并完成了园区市政道路、大部分绿化景观水体等环境工程建设项目，以及强弱电、供水、供气等外部管网工程建设。江苏联环、湘北威尔曼、北京双鹭等 9 家企业总部项目签约入驻，并有江苏开元医药、江苏全能干细胞生物工程、南京斯贝源等 60 家孵化器企业签约落户。南京大学、南京师范大学、中国药科大学、南京中医药大学的 14 个重点实验室、研究中心进驻园区。

江苏生命科技创新园定位为重点发展生物医药产业，生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成。园区内主要有以下几大类用地：研发用地、总部办公用地、管理用地、服务平台用地、孵化用地、技术中心用地、公园绿化用地等等。

江苏生命科技创新园的生物医药实验室采用密闭方式，排出废气污染物经由活性炭吸附装置进行处理。园区在 C6、D6、D7、E6、E7 幢合建一座 300m³/d 的污水处理站收集 C6、D6、D7、E6、E7 幢企业的废水，本项目位于 D6 栋，实验室废水接入园区污水处理站预处理达标后，再排入仙林污水处理厂。目前该污水处理站已投入运行且运行状况良好。

园区雨水直接排入南侧河道，生活污水和实验污水（不含废液）分别经预处理达接管标准后进入园区南侧市政污水主管井，进入仙林污水处理厂处理，园区污水管网接管图见附图 6。园区企业危废委托有危险废物处置资质的单位处置。

环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）：

一、建设项目所在区域环境质量现状

根据南京市大气环境功能区划，本项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《南京市环境状况公报》（2017年），南京市建成区 SO₂ 年均值为 16ug/m³，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；PM_{2.5} 年均值 40μg/m³，超标 0.14 倍；PM₁₀ 年均值为 76μg/m³，超标 0.09 倍；NO₂ 年均浓度约为 47ug/m³，超标 0.18 倍，出现一定程度的超标现象。其中 NO₂ 和 PM_{2.5} 超标主要原因为大量汽车尾气所致，PM₁₀ 超标主要原因评价区内建筑工地较多，地面裸露，施工扬尘较大。

本项目所在地周围不存在对环境产生较大影响的噪声源，其声环境质量能达到 2 类区划功能的要求。

长江总体水质稳定，水质现状为 II 类，水质良好。

二、周边污染源情况及主要环境问题

本项目位于江苏生命科技创新园内，江苏生命科技创新园位于仙林大学城高校科技产业园区中 312 国道以南、九乡河以东，毗邻南京大学仙林国际化校区，东临元化路（原西山路），西侧为西山变电站，南临纬地路（原万象路），北临规划中的齐民西路。

本项目周边污染源对环境产生的影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

该项目污染控制目标为项目建成后污染物达标排放，排污口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，水、气、声环境保护目标见表。

表 6 建设项目环境保护目标

环境类别	保护目标名称	方位	距离（米）	规模	环境功能
地表水	长江	北	4000	特大型河流	《地表水环境质量标准》II类 (GB3838-2002)
	九乡河	西	931	小河	《地表水环境质量标准》V类 (GB3838-2002)
大气环境	南京大学仙林校区	南	480	7000 人	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单二类标准
	南京信息职业技术学院	西	1300	12000 人	
	南京工业职业技术学院	西南	1500	10000 人	
	九乡河小区	西北	1000	45000m ²	
	大圩村	北	680	100 人	
	保利罗兰春天	东	1600	3500 人	
	枫情水岸	东	1400	3000 人	
声环境	江苏生命科技创新园	-	-	450000 m ²	《声环境质量标准》2类
生态环境	栖霞山国家森林公园	北	160	二级管控区面积 7.49km ²	自然与人文景观保护
	龙潭饮用水水源保护区	北	3700	一级管控区面积 4.91km ² , 二级管控区面积 2.39km ²	水源水质保护

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《南京市生态红线区域保护规划》，本项目不位于生态红线一级、二级管控区内。项目距最近的生态红线保护区域栖霞山国家森林公园 160m，距龙潭饮用水水源保护区 3700m，项目建设对栖霞山国家森林公园、龙潭饮用水水源保护区影响小。本项目与南京市生态红线区域位置关系图见附图 5。

评价适用标准

环境 质量 标准	环境质量标准			
	一、大气环境			
	<p>建设项目位于南京市栖霞区仙林大学城，属大气环境功能二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，具体指标数值列于表。</p> <p>本项目常规大气污染物及氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC、甲醇、苯胺、氨《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 参考限值。</p>			
	表 7 环境空气质量标准			
	污染物名称	取值时间	浓度限值 (ug/m ³)	标准来源
	SO ₂	24 小时平均	150	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及修改单二级标准
		1 小时平均	500	
	NO ₂	24 小时平均	80	
		1 小时平均	200	
	PM ₁₀	24 小时平均	150	
氟化物	1 小时平均	20		
	日平均	7		
TVOC	8 小时平均	600	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ 2.2-2018) 附录 D	
甲醇	1 小时平均	3000		
	日平均	1000		
氨	1 小时平均	200		
苯胺	1 小时平均	100		
	日平均	30		
二、地表水环境				
<p>项目所在地周围水体长江、九乡河分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II、V 类标准，SS 参照《地表水资源质量标准》（SL-94），具体指标详见表 8。</p>				
表 8 地表水环境质量标准主要指标值				
序号	项目名称	II 类标准值 (mg/L)	V 类标准值 (mg/L)	
1	pH	6~9 (无量纲)	6~9 (无量纲)	
2	SS	≤25	≤150	
3	COD	≤15	≤40	
4	BOD ₅	≤3	≤10	
5	高锰酸盐指数	≤4	≤15	
6	NH ₃ -N	≤0.5	≤2.0	
7	TP	≤0.1	≤0.4	
8	石油类	≤0.05	≤1.0	

三、声环境

按照《南京市声环境功能区划调整方案》（2013）规定，江苏生命科技创新园属于 2 类区，环境噪声应达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准，具体标准值见表 9。

表 9 声环境质量标准（等效声级：dB（A））

标准	昼间	夜间
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准	60	50

污染物排放标准

一、废气

TVOC、氨执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2 特别排放限值要求，甲醇、苯胺类、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值。由于 D6 栋低于周围 200m 范围内 D7 栋（约 80m）的高度，因此，该项目甲醇、苯胺类、氟化物污染物排放速率严格 50% 执行，具体指标数值列于表 10。VOCs 无组织排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录 C（监测非甲烷总烃 NMHC），详见表 11。

表 10 大气污染物废气排放标准

污染物	最高允许排放浓度 mg/m ³	排气筒高度 (m)	最高允许排放速率 kg/h		无组织排放监控浓度限值		标准来源
			二级	本项目	质控点	浓度 mg/m ³	
TVOC	100	50	/	/	周界外浓度最高点	/	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）
氨	20		/	/		/	
甲醇	190		77	38.5*		12	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2
苯胺类	20		7.7	3.85*		0.4	
氟化物	9		1.5	0.75*		0.02	

注*：项目排气筒高度低于周边 200m 范围内建筑，排放速率标准值严格 50% 执行。

表 11 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	任意一次浓度值	

二、废水

企业的废水主要来自办公生活污水、实验废水、衣服清洗废水。项目所排放的生活污水依托园区现有化粪池处理，实验废水、洗衣废水依托园区废水预处理装置处理，达到仙林污水厂二期接管标准要求后，通过市政污水管网进入仙林污水处理厂处理，废水经南京仙林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后由九乡河排入长江。建设项目的污水排放标准列于

表 12。

污染物排放标准

表 12 建设项目污水排放标准（单位：mg/L）

项目	园区预处理装置接管标准	仙林污水厂二期接管标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准 (仙林污水处理厂出水水质)
pH (无量纲)	6~9	6~9	6~9
CODcr	≤2500	≤350	≤50
SS	≤400	≤200	≤10
氨氮	≤50	≤40*	≤5 (8) **
TP	/	≤4.5*	≤0.5
TN	/	/	≤15
动植物油	/	≤100	≤1
石油类	/	≤20	≤1
LAS	/	/	≤0.5

注：*：NH₃-N和TP接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。

**：括号外数值为水温>12 度时的控制指标，括号内数值为水温≤12 度时控制指标。

三、噪声

建设项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，详见表。项目施工期间的噪声应不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所列标准，详见表。

表 13 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A））

类别	昼间	夜间
2	60	50

表 14 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位 dB（A））

昼间	夜间
70	55

四、固废

危险固废的暂存执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

总 量 控 制 指 标	<p>总量控制指标：</p> <p>(1) 废水</p> <p>项目废水依托园区预处理设施达到仙林污水厂二期接管标准要求后，通过市政污水管网进入仙林污水处理厂。</p> <p>园区预处理设施出水考核指标为：园区预处理设施出水考核指标为：废水排放 1582t/a，COD 0.4781t/a，SS 0.2713t/a，氨氮 0.0244t/a，总磷 0.0019t/a，总氮 0.0252t/a，LAS0.0014t/a。项目水污染物经污水处理厂处理后出水总量控制指标为：废水排放量 1582t/a，COD 0.0791t/a，SS 0.0158t/a，氨氮 0.0079t/a，总磷 0.0008t/a，总氮 0.0237t/a、LAS0.0008t/a。</p> <p>根据《关于排污权交易的有关事项》（宁环办[2016]121号）：建设项目新增化学需氧量、氨氮主要污染物指标均未达到 0.1t/a，该项目暂不作为排污权交易的管理对象，统一纳入排污权有偿使用管理。</p> <p>(2) 废气</p> <p>根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119 号），县级以上地方人民政府统筹负责本行政区域内挥发性有机物污染防治工作，严格控制和有计划削减挥发性有机物排放总量。因此，大气污染物总量控制指标为：废气排放量为 1080 万 m³/a，VOCs 0.0535t/a，项目 VOCs 暂不属于省、市年度总量控制指标，因此，近期作为区域自控指标，待相关管理办法出台后按要求执行。</p> <p>(3) 固体废物</p> <p>建设项目固体废物为生活垃圾、废包装材料，实验废液（包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等），废包装容器（废试剂瓶、废空桶等），废样品，废活性炭，废滤膜，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等，均妥善处置，零排放。</p>
----------------------------	---

建设项目工程分析

建设项目工艺流程简述（图示）：

1、研发工艺流程

项目仅进行医药研发，不涉及生产。研发内容包括：制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究，包括片剂、胶囊剂以及外用凝胶剂等剂型，所研究的药物主要包括心血管系统以及消化系统类药物。企业典型研发流程见图 1：

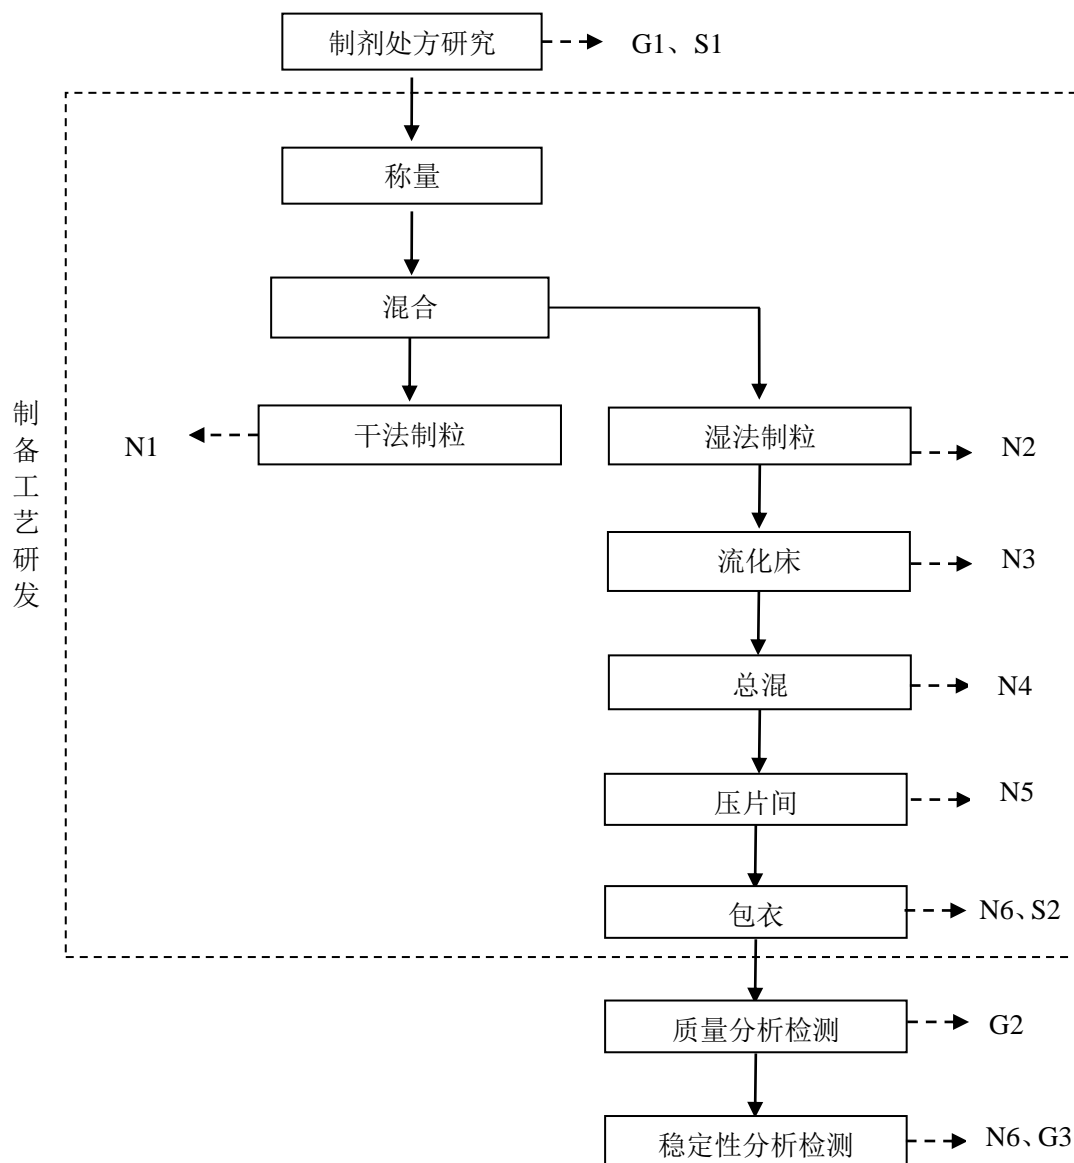


图 1 项目研发工艺流程图

研发实验的基本工艺流程为：

(1) 制剂处方研究：配置不同的试剂，对样品进行检验，然后根据检验结果筛选出需要添加原辅料的量，此过程配置试剂溶液、检验等实验过程挥发性化学试剂会产生挥

发性废气 G1，产生固废 S1，主要包括检测废液、废试剂、一次性耗材、废样品、废包装等。

(2) 制备工艺研发，主要包括：

称量：根据筛选的原辅材料进行称重；

物料混合：将原料与辅料以一定比例及顺序通过物料混合机混合均匀；

制粒：将混合均匀的物料经湿法制粒机或干法制粒机制成颗粒；

总混：通过物料混合机将颗粒加入适当的辅料进行最后的总混；

压片（或装胶囊）：将总混后的颗粒以特定的设备压制成一定大小的片剂，或灌装于特定大小的胶囊壳中，该工序主要用到压片机或胶囊灌装机；

包衣：必须的时候将片剂或颗粒进行包衣，该工序主要用到包衣机；

包装：将包衣后的片剂或颗粒进行包装，即得最终样品；

此过程制粒机、混合机、包装机等设备产生噪声 N1~N6，产生废样品 S2。

(3) 分析方法的开发：根据制剂特点，按照中国药典及相应指导原则要求开发出一整套能够评价该制剂质量的分析方法，评价检测过程中使用挥发性溶剂配置检测试剂，配置检测工程中产生挥发性废气 G2。产生固废 S3，主要包括检测废液、废试剂、一次性耗材、废样品、废包装等。

(4) 依据所开发的分析方法对制剂的加速及长期稳定性试验进行质量考察，以确保所开发的制剂质量稳定可控。评价检测过程中使用挥发性溶剂，产生少量挥发性废气 G3。产生固废 S4，主要包括检测废液、废试剂、一次性耗材、废样品、废包装等。

(5) 其他产污环节分析

本项目生产过程中会产生相应类别的其他污染物，主要为危废贮存区挥发性废气 G4。纯水系统制水过程产生的浓水 W1、实验室仪器设备清洗废水 W2（不含初次清洗废液）、职工生活污水 W3、废气处理装置产生的废活性炭 S5、实验装置首次清洗废液 S6，和其他一般固废 S7（未接触原辅料的废外包装和生活垃圾）。

主要污染工序：

一、废气

由于研发项目存在不确定性，企业仅列出可能使用的主要原辅材料，根据原辅材料特性分析，项目废气主要为实验过程中使用挥发性化学品和贮存挥发性危险废物产生的挥发性废气，挥发性废气主要为：醇类、乙腈、吡啶、二乙胺、四氢呋喃、正庚烷、正辛烷、苯胺、乙酸等挥发性化学品产生的有机废气，氨水等产生的少量含氨碱性废气，三氟乙酸产生的含氟化物酸性废气。

项目涉及挥发性化学品的研发实验均在通风柜内进行，实验过程中产生的废气可以得到较好的收集。危险废物贮存区废气收集后与实验废气一并处理。

考虑到项目氨水、三氟乙酸、苯胺的年用量非常少（5kg/a、0.2kg/a、0.5kg/a），类比同类项目，可实现达标排放，因此本次报告不进行定量分析。对于其他挥发性有机物，因本实验室使用种类较多且各自用量均不大，故污染因子以 VOCs 表征（甲醇最高允许排放浓度以及无组织排放浓度限值均大于 VOCs）。由于 VOCs 没有具体的排放标准和评价标准，本次报告选取 TVOC 作为影响评价因子。

考虑到项目试剂存储、实验使用、危废存储全过程，虽然反应过程改变了试剂本身的性质，但是由于仍然是以小分子、易于挥发的状态存在，因此 VOCs 的挥发量以其使用量（1.189t/a）的 20% 计算，约为 0.2378t/a。挥发性有机废气有效收集量均以其挥发量的 90% 计。危险废物中的实验废液、检测废液具有挥发性，因此危险废物贮存区有少量有机废气逸散，这些废气拟通过吸风口收集至通风橱管道，然后通过管道排至位于楼顶的活性炭吸附装置处理后排放。建设项目进行实验室废气挥发量核算时已经囊括了原辅材料的实验过程和最终去向（进入危险废物后挥发），因此危险废物贮存区挥发性废气无需另行核算。

实验室内产生的废气污染物经收集后，通过园区内置废气管道引至大楼楼顶后由活性炭吸附装置处理，处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒排放高度约 50m。项目拟新建 1 个排气筒，风机风量为 18000m³/h。废气排放时间以 600h/a（2.5h/d，一年工作 240 天）计算。

《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）4.3 规定：对于重点地区，排气筒 TVOC 允许排放浓度为 100mg/m³，排气筒中 NMHC（非甲烷总烃）初始排放速率大于 2kg/h，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不低于 80%。本项目 VOCs 产生浓度为 19.81mg/m³，产生速率 0.3567kg/h，均满足该标准要求。但是为了进一步削减污染物总量，

本项目拟对收集的有组织有机废气进行活性炭吸附处理，处理效率 75%。建设项目大气污染物产生及排放情况见表。

表 14 建设项目大气污染物产生及排放情况

污染源	废气量 Nm ³ /h	污染物名称	产生情况			处理方法	处理效率	排放情况			排放标准		达标情况
			浓度	速率	产生量			浓度	速率	排放量	浓度	速率	
			mg/m ³	kg/h	t/a			mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	
P1	18000	VOCs	19.81	0.3567	0.214	活性炭吸附	75%	4.95	0.0892	0.0535	100	/	达标

建设项目废气源强核算结果及相关参数汇总见表 15~17。

表 15 大气污染物有组织正常工况排放核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/(mg/m ³)	核算排放速率/(kg/h)	核算年排放量/(t/a)
1	P1	VOCs	5.5	0.0991	0.0595

表 16 大气污染物有组织非正常工况排放核算表

排放口编号	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率/(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次
P1	活性炭吸附饱和，失去处理能力	VOCs	0.3567	1	0.5

表 17 本项目大气污染物无组织排放核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准	浓度限值/(mg/m ³)		年排放量/(t/a)
					标准名称	1h 平均值	24 小时平均值	
1	实验室	实验	VOCs	-	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)	6	20	0.0238

根据估算模式 AREScreen，依据以上相关参数计算结果本项目无超标点，因此本项目不需设置大气环境保护距离。

二、废水

①生活污水

建设项目员工 50 人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》办公楼生活用水量按 1.5m³/(人·月)计，则建设项目营运期生活用水总量约为 900t/a，排放

系数以 0.8 计，则生活污水排放量约为 720t/a。生活污水主要污染物为 COD、SS、氨氮和 TP。

②纯水制备浓水

本项目所需纯水约 7t/a，其中 4t/a 用于最后一道清洗，3t/a 用于溶液配置。纯水制备效率为 50%，则纯水制备系统需要新鲜自来水约 14t/a，反渗透浓水 7t/a，主要污染物为 COD、SS。纯水制备系统浓水进园区生化处理装置预处理后，排入仙林污水处理厂处理。

③实验废水

项目实验用水包括研发过程用水、容器清洗用水和循环冷却用水。

研发过程用水主要用于溶液配置，使用纯水，用量 3t/a，作为危险废液处理。

实验结束后，需要将实验仪器和设备进行清洗，以便下一个实验能够顺利进行；实验过程中需要使用循环冷却水，需排放的循环冷却水作为清洗水使用后与其余实验废水一并排放。容器清洗用水参照同类实验室，用水量约为 840t/a（按 $2.0\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{月})$ ，实验员约 35 人计），其中最后一道采用纯水清洗（4t/a）。循环冷却用水量约为 $15\text{m}^3/\text{a}$ 。项目全年清洗水及循环冷却水用量为 855t/a，其中初次清洗用水量约 10t/a。

项目实验废水主要为清洗废水（不包括初次清洗）和循环冷却水，约为 845t/a。排放系数以 0.9 计，预计废水约为 760.5t/a，实验废水进园区生化处理装置预处理后，排入仙林污水处理厂处理。建设项目水平衡图见 2。

③洗衣废水

建设项目有员工 50 人，其中实验人员约 35 人，参照《江苏省城市生活与公共用水定额（2012 年修订）》洗衣房用水量按 50L/kg 干衣服，按照每人每两天换洗一次，每件衣服 0.5kg，全年按照 240d 计算，则建设项目营运期员工实验服清洗用水总量约为 105t/a，排放系数以 0.9 计，则洗衣废水排放量约为 94.5t/a。洗衣废水主要污染物为 COD、SS、氨氮和 LAS。

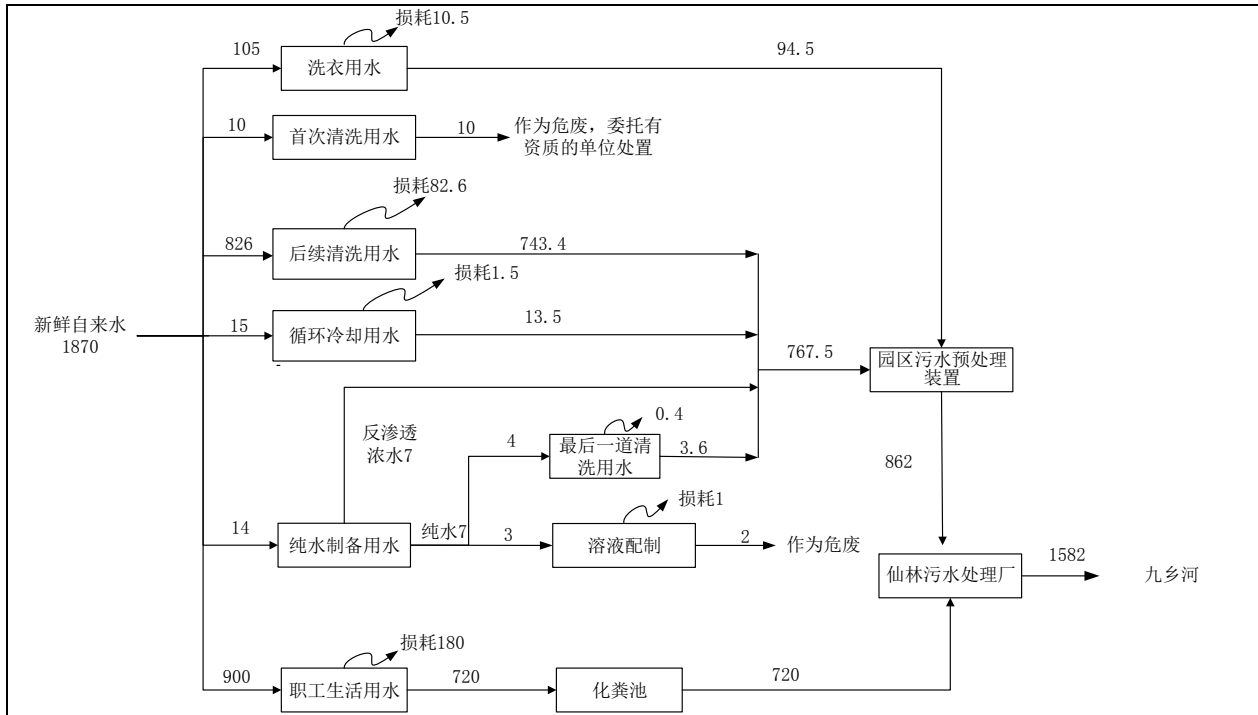


图 2 建设项目水平衡图 (t/a)

建设项目废水的污染物产生状况见表。

表 18 建设项目废水的污染物产生状况一览表

污染源	废水量 m ³ /a	污染物	污染物产生		处理措施	污染物排放		标准 浓度 限值 mg/L	排放方 式及去 向
			浓度 mg/L	产生量 t/a		浓度 mg/L	排放量 t/a		
生活污水	720	COD	350	0.2520	依托园 区现有 化粪池 处理	245	0.1764	/	污水经 园区预 处理后 达到仙 林污水 厂二期 接管标 准,然后 排入仙 林污水 处理厂 集中处 理,达标 后排入 九乡河
		SS	200	0.1440		140	0.1008	/	
		NH ₃ -N	40	0.0288		30	0.0216	/	
		TP	3.5	0.0025		2.63	0.0019	/	
		TN	50	0.0360		35	0.0252	/	
实验废水	767.5	COD	1000	0.7675	依托园 区现有 生化处 理装置 预处理	350	0.2686	/	
		SS	500	0.3838		200	0.1535	/	
洗衣废水	94.5	COD	500	0.0473	依托园 区现有 生化处 理装置 预处理	350	0.0331	/	
		SS	250	0.0236		180	0.0170	/	
		NH ₃ -N	35	0.0033		30	0.0028	/	
		LAS	20	0.0019		15	0.0014	/	
合计	1582t/a	COD	674.3	1.0668	依托园 区预处 理	302.2	0.4781	350	
		SS	348.5	0.5514		171.5	0.2713	200	
		NH ₃ -N	20.3	0.0321		15.4	0.0244	40	
		TP	1.6	0.0025		1.2	0.0019	4.5	
		TN	22.8	0.036		15.9	0.0252	/	

		LAS	1.2	0.0019		0.9	0.0014	/	
--	--	-----	-----	--------	--	-----	--------	---	--

三、噪声

该项目噪声主要来自引风机，位于 D6 栋顶楼，其噪声强度如表所示。

表 19 建设项目主要噪声设备一览表

序号	设备名称	数量(台)	单台噪声值(dB(A))	所在车间(工段)名称	距最近厂界位置(m)	治理措施	单台降噪效果(dB(A))
1	引风机	2	75	-	北厂界 25m	减震、隔声	38

四、固体废物

根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)，建设项目副产物产生情况汇总表见表。建设项目固体废物主要为生活垃圾及废包装材料，实验废液(包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等)，废包装容器(废试剂瓶、废空桶等)，废样品，废活性炭，废滤膜，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等。

(1) 生活垃圾

拟建项目设员工 50 人，生活垃圾产生量按 1kg/(人·d) 计，年工作时间为 240d，则每年生活垃圾产生量为 12t/a。

(2) 废包装材料

主要为未与物料直接接触的纸盒、塑料袋等，约 0.05t/a。

(3) 实验过程中产生的固体废物

① 实验废液(包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等)

根据企业提供的资料，项目使用的原辅料中，所用试剂的总用量约为 1.194t/a，挥发性物质的量约为 0.238t/a，进入实验废液的量约为 0.955t/a，研发过程中加入的水进入废液量约为 2t/a，项目初次清洗废液的量约为 10t/a，则实验废液产生量约为 12.955t/a。

② 废包装容器(废试剂瓶、废空桶等)

类比同类实验室，该项目废试剂瓶、废空桶等等产生量约为 0.5t/a。

③ 废样品

项目产生的所有样品在留样室留存 2 年后，全部作为危险废物处理，预计年产生废样品 0.4t。

④ 废活性炭

项目有机试剂的挥发量约为 0.238t/a，废气的收集率为挥发量的 90%，有组织收集量 0.214t/a，活性炭的处理效率按照 75% 计，按照 1t 活性炭吸附 0.3t 有机物计算，则项目废气处理产生的废活性炭产生量约为 0.72t/a。计划活性炭更新周期如表 20 所示。

表 20 项目活性炭使用及更新情况一览表

排气筒编号	污染物名称	产生量 t/a	吸附效率	吸附量 t/a	废气排放时间 h/a	活性炭吸附能力 t/t 污染物	活性炭理论用量	活性炭箱设计容量 t	活性炭更新周期
P1	VOCs	0.214	75%	0.72	600	0.3	0.72	0.15	两月一次

⑤ 纯水制备仪废滤膜

项目实验用水使用纯水制备仪自制，纯水制备仪过滤滤膜需要定期更换。根据企业提供资料，纯水制备仪废滤膜更换量约 0.01t/a，一年更换一次。

⑥ 废手套、试纸、注射器、移液器枪头等

根据估算，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等产生量约 0.2t/a。

根据建设项目危险废物环境影响评价指南、《危险废物鉴别标准 通则》及《国家危险废物名录》（2016）进行属性判定。项目副产物产生情况见表，项目固体废物属性分析结果汇总表见表，项目危险废物汇总表见表。

表 21 建设项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量(吨/年)	种类判断		
						固体废物	副产品	判定依据*
1	实验废液	实验室	液态	有机物	12.955	√	/	4.2-c
2	废包装容器 (废试剂瓶、 废空桶等)	实验室	固态	玻璃、塑料等	0.5	√	/	5.1-b
3	废样品	实验室	固/液	有机物	0.4	√	/	4.1-a
4	废活性炭	废气处理	固态	碳、有机物	0.72	√	/	4.3-1
5	废滤膜	纯水制备	固态	反渗透膜、过滤物	0.01	√	/	4.1-d
6	废手套、试纸、 注射器、移液器枪头等	实验室	固/液	沾染有机物等的手套、试纸等耗材	0.2	√	/	5.1-b
7	生活垃圾	员工	固态	/	12	√	/	5.1-c
8	废包装材料	包装物	固态	纸盒、塑料等	0.05	√	/	4.2-1

注：*判定依据为《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

表 22 项目固体废物属性分析结果汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别及代码	产生量(t/a)
1	实验废液	危险废物	实验室	液态	有机物	《国家危险废物名录》(2016)	T/C/I/R	HW49 900-047-49	12.955
2	废包装容器 (废试剂瓶、 废空桶等)		实验室	固态	玻璃、塑料等		T/In	HW49 900-041-49	0.5
3	废样品		实验室	固/液	有机物		T/C/I/R	HW49 900-047-49	0.4
4	废活性炭		废气处理	固态	碳、有机物		T/C/I/R	HW49 900-047-49	0.72
5	废手套、试纸、注射器、移液器枪头等		实验室	固/液	沾染有机物等的废手套、试纸、注射器、移液器枪头等		T/C/I/R	HW49 900-047-49	0.2
6	废滤膜		纯水制备	固态	反渗透膜、过滤物		T/C/I/R	HW49 900-047-49	0.01
7	生活垃圾	/	员工生活	固态	/	/	/	/	12
8	废包装材料	/	包装物	固态	纸盒、塑料等	/	/	/	0.05

表 23 建设项目危险废物排放和处置一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	实验废液	HW49 其他废物	900-047-49	12.955	实验室	液	有机物	有机物	每天	T/C/I/R	暂存于危废贮存间,定期交有资质单位处置
2	废包装容器 (废试剂瓶、 废空桶等)		900-041-49	0.5	实验室	固	玻璃、塑料等	有机物	/	T/In	
3	废样品		900-047-49	0.4	实验室	固/液	有机物	有机物	/	T/C/I/R	
4	废活性炭		900-047-49	0.72	废气处理、纯水制备、研	固	碳、有机物	有机物	每年	T/C/I/R	

				发实验						
5	废手套、试纸、注射器、移液器枪头等	900-047-49	0.2	实验室	固/液	沾染有机物等的手套、试纸、塑料管等	有机物	每天	T/C/I/R	
6	废滤膜	HW49 900-047-49	0.01	纯水制备	固态	反渗透膜、过滤物	有机物	每年	T/C/I/R	
合计			14.785	/	/	/	/	/	/	/

五、本项目建成后公司污染物排放情况汇总

本项目建成后公司总的污染物排放汇总如表 24 所列。

表 24 本项目建成后公司污染物排放情况汇总（单位 t/a）

种类	污染物名称	污染物产生量	削减量	污染物排放量 (接管量)	最终排入环境的量
废水	废水量	1582t/a	0	1582t/a	1582t/a
	COD	1.0668	0.5887	0.4781	0.0791
	SS	0.5514	0.2801	0.2713	0.0158
	氨氮	0.0321	0.0077	0.0244	0.0079
	总磷	0.0025	0.0006	0.0019	0.0008
	总氮	0.036	0.0108	0.0252	0.0237
	LAS	0.0019	0.0005	0.0014	0.0008
有组织废气	VOCs	0.214	0.1605	0.0535	0.0535
无组织废气	VOCs	0.0238	0	0.0238	0.0238
固废	实验废液	12.955	12.955	/	0
	废包装容器（废试剂瓶、废空桶等）	0.5	0.5	/	0
	废样品	0.4	0.4	/	0
	废活性炭	0.72	0.72	/	0
	废手套、试纸、注射器、移液器枪头等	0.2	0.2	/	0
	废滤膜	0.01	0.01	/	0
	生活垃圾	12	12	/	0
废包装材料	0.05	0.05	/	0	

项目主要污染物产生及预计排放情况

种类	排放源(编号)	污染物名称	废气量 万 m ³ /a	产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放去向	
大气污染物	有组织废气	VOCs	1080	19.81	0.214	4.95	0.0892	0.0535	大气	
	无组织废气	VOCs	/	/	0.0238	/	0.0238	0.0238		
水污染物	排放源	污染物名称	废水量 t/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	园区预处理出水		污水处理厂出水		排放去向
						排放浓度 mg/L	排放量 t/a	排放浓度 mg/L	排放量 t/a	
	实验废水、生活污水、洗衣废水	COD	1582	674.3	1.0668	302.2	0.4781	50	0.0791	九乡河
		SS		348.5	0.5514	171.5	0.2713	10	0.0158	
		氨氮		20.3	0.0321	15.4	0.0244	5	0.0079	
		总磷		1.6	0.0025	1.2	0.0019	0.5	0.0008	
		总氮		22.8	0.036	15.9	0.0252	15	0.0237	
LAS	1.2	0.0019	0.9	0.0014	0.5	0.0008				
固体废物	排放源	产生量 t/a	处理处置量 t/a	综合利用量 t/a	外排量 t/a	排放去向				
	危险废物	14.785	14.785	0	0	临时贮存，交有危险废物处置资质的单位上门收集处置				
	生活垃圾	12	12	0	0	环卫统一收集处理				
噪声	隔声、减震							达标		
<p>主要生态影响（不够时可附另页）：</p> <p>建设项目为购买江苏生命科技创新园的现有房屋进行建设，不新增占地，无土建施工，对生态影响小。</p>										

环境影响分析

施工期环境影响分析及污染防治措施简述

建设项目租用现有房屋（D6 栋 809、810、811 室）进行建设，施工期主要为室内的装修和试验设备安装调试，施工期较短，工程量很小，施工期对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析及污染防治措施简述

1、水污染防治措施及环境影响分析

（1）废水污染防治措施

实验废水、洗衣废水经过园区废水处理装置预处理，生活污水经过园区化粪池预处理，预处理后的废水达到仙林污水厂二期接管标准后，接入园区南侧市政污水主管井，最终排入仙林污水处理厂处理，处理达标后的尾水排入九乡河，最终排入长江。

1) 实验废水依托园区预处理设施处理可行性

园区在 C6、D6、D7、E6、E7 幢合建一座 300m³/d 的污水处理站收集 C6、D6、D7、E6、E7 幢企业的废水，本项目位于 D6 栋 809、810、811 室，实验废水、洗衣废水接入园区污水处理站预处理达标后，再排入仙林污水处理厂。本项目日产生废水量约 3.58m³/d，园区污水收集管网已经建成，污水处理装置已于 2018 年 1 月 31 日竣工，已正式投入运行并能够稳定达标排放（（2018）（高博）环检（水）字（15）号），截止目前实际收集水量约 25m³/d，余量富足。园区预处理工艺采用物化法加生化法，如图 3 所示，其流程说明如下：

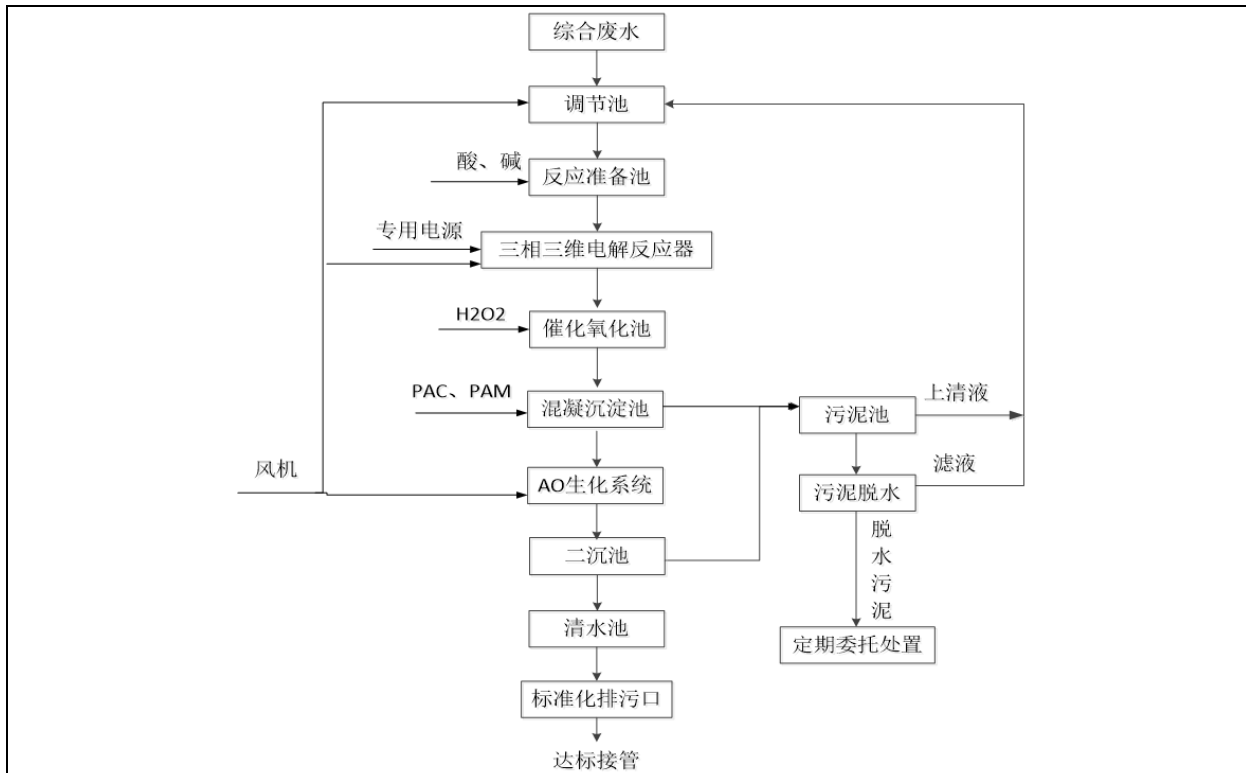


图 3 园区废水预处理工艺流程图

园区预处理工艺流程说明：

①由于该大楼内企业白天运行，晚上基本不运行，废水的排放具有间歇性和多变性，需设置调节池调节废水的水质及水量，以保证后续处理设施能均质、均量进水。同时以保证事故时能有效地接纳装置排水，避免事故废水进入水体造成污染。因此综合废水通过管道集中收集排入调节池中进行均质均量。

②调节池中的废水通过水泵泵入反应准备池（池内设搅拌装置）中，根据废水中不同酸碱程度，开启不同的加药罐（酸性和碱性加药罐，罐内设搅拌系统）中的药剂通过加药泵泵入反应准备池。

③反应准备池的废水流入三相三维电解反应床进行处理。三相三维电解反应床根据废水中需要去除的污染物的种类和性质，在两个主电极之间充填高效、无毒的颗粒状专用材料、催化剂及一些辅助剂，组成去除某种或某一类污染物的最佳复合填充材料作为粒子电极。当反应准备池的废水流经这套电致多相催化高级氧化装置时，在一定的操作条件下，装置内便会连续不断地产生一定数量的具极强氧化性能的羟基自由基（ OH ）和新生态的混凝剂。这样，废水中的污染物便会产生诸如催化、氧化、分解、还原、混凝、吸附等一系列物理化学反应，使废水中的有机污染物得以迅速去除。

④三相三维电解反应床的出水流入催化氧化反应池，通过加 H_2O_2 产生芬顿反应，反

应完出水流至混凝沉淀池沉淀掉已降解的 COD。

⑤混沉池出水进入 A/O 生化系统进行进一步处理，A/O 生化系统出水进入二沉池去除生化系统脱落的生物膜，二沉池出水进入气浮池，气浮处理后的浮渣与污泥分别排入浮渣池与污泥池，上清液回流至调节池，浮渣与脱水污泥定期委外处置。气浮池出水进入排放水池通过标准化排污口达标排放。

根据设计单位提供的资料，预计园区预处理装置对 COD_{Cr} 的去除率不小于 65%，该工艺已经被广泛应用，技术经济可行。

建设项目产生的废水主要为生活污水、实验清洗废水、洗衣废水和纯水制备废水，其中生活污水量约 720t/a，经过化粪池预处理后直接接入仙林污水厂的生活污水管网。根据《江苏仙林生命科技创新园项目废水处理工程设计方案》确定 C6、D6、D7 废处理站设计进水水质中主要 COD 控制指标为≤2500mg/L，而本项目实验室废水 COD 浓度不超过 1000mg/l，可以满足废水处理站进水水质指标要求。本项目洗涤废水 LAS 浓度约 15mg/L，浓度较低，预处理工艺对洗衣废水中的 LAS 有一定的处理效果。该污水处理站的设计处理能力为 300m³/d，截止目前该污水站实际收集水量约 25m³/d，余量可以满足本项目实验室总废水量为 862t/a（3.58t/d）的处理水量要求。

因此，从处理工艺及处理规模考虑，项目依托园区废水预处理设施可行。

建设项目的生产应根据园区废水预处理设施运行情况，及时与园区协调沟通，安排实验进度及废水排放情况，确保废水达标排放。园区委托南京恒川环保科技有限公司每日对该污水装置的废水水质和废水量进行检测，检测单位发现超过园区废水预处理设施运行能力或污水出口水质水量异常时及时通报园区管委会，管委会要求各企业停止实验，停止向该污水站排放废水。

2) 污水处理厂接管可行性

江苏生命科技创新园污水收集系统属于白象片区污水收集系统，白象片区污水收集系统包括 15 条道路的污水收集管道，管道总长度约 36 公里，另外包含污水提升泵站一座。白象片区污水收集系统于 2008 年底建成并投入使用。仙林污水处理厂的二期规模为 5 万 m³/d，可完全容纳本项目污水。

(2) 水环境影响评价

仙林污水处理厂污水处理工艺采用循环式活性污泥法（CAST）。根据《南京市仙林大学城污水处理系统工程环境影响报告书》评价结果，该污水处理厂正常运行后，正常排放情况下，对九乡河 COD 浓度贡献值小于 1mg/m³，该河流的 COD 浓度仍可满足

功能要求，所以建设项目废水对外环境的影响较小。

因此，项目废水处理依托处理可行，对周围水环境影响很小。

2、大气污染防治措施及环境影响分析

(1) 废气污染防治措施

项目废气主要为实验过程中产生的挥发性有机废气。项目涉及挥发性化学品的研发实验均在通风柜内进行，实验过程中产生的废气可以得到较好的收集。危险废物贮存区废气收集后与实验废气一并由大楼内置废气管道引至大楼楼顶配套活性炭吸附装置，处理达标后通过排气筒高空排放，项目拟设 1 个废气排口，位于 D6 栋顶楼，排气筒排放高度约 50m。

实验室有机废气的收集效率约 90%，活性炭吸附装置吸附效率约 75%，项目废气经拟建活性炭吸附装置处理后能够满足标准要求。拟建废气排口处应按规定设置采样口，便于日常环境监测及管理。建设项目活性炭吸附装置中的活性炭应定期更换、维护。

①废气处理达标可行性分析

活性炭是一种优良的吸附剂，用木炭、椰壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选加工制造而成，具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以选择吸附气相、液相中各种物质。随着气体处理量的逐步加大，活性炭的活性会逐渐减弱，因此为了保证去除率，应加强活性炭的日常管理，根据项目去除的有机污染物量和活性炭的吸附容量，定期更换活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，本项目活性炭对废气的去除率约为 75%，经活性炭吸附净化后的废气可实现达标排放。

②废气处理经济可行性分析

本项目处理废气的活性炭吸附设备使用的活性炭需要定期更换，本项目需使用活性炭量约为 0.72t/a，相对价格较低，根据核算，活性炭更换周期为两月一次。

(2) 大气环境影响分析

1) 评价等级判别

评价等级分级判据按表 25 的进行划分。

表 25 评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$

三级评价

$P_{max} < 1\%$

2) 排放源参数

表 26 点源排放参数

污染源名称	坐标(°)		坐标(°)	排气筒参数				污染物名称	排放速率	单位
	经度	纬度		高度(m)	内径(m)	温度(°C)	流速(m/s)			
点源	118.953536	32.135923	15.0	50.0	0.5	20	25.0	TVOC	0.0892	kg/h

表 27 面源排放参数

污染源名称	左下角坐标(°)		海拔高度(m)	矩形面源			污染物	排放速率	单位
	经度	纬度		长度(m)	宽度(m)	有效高度(m)			
矩形面源	118.953357	32.13603	15.0	55.0	30	40.0	TVOC	0.0396	kg/h

2) 评级工作等级确定

根据采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算本项目所有污染源的正常排放的污染物的 P_{max} 和 $D_{10\%}$ 预测结果见表 28。

表 28 P_{max} 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{max}(\%)$	$D_{10\%}(\text{m})$
点源	TVOC	1200.0	30	2.5	/
矩形面源	TVOC	1200.0	5	0.41	/

本项目 P_{max} 最大值出现为点源排放的 TVOC, P_{max} 值为 2.5%, C_{max} 为 $30\mu\text{g}/\text{m}^3$, 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据, 确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据导则要求, 二级评价项目不进行进一步预测与评价, 只对污染物排放量进行核算。

综上所述, 项目废气经活性炭吸附装置吸附处理后能够达到相应排放标准, 项目废气经活性炭吸附装置处理可行。建设项目排放的大气污染物对周围环境影响较小, 不会改变周围大气的环境功能。

(3) 噪声

该项目噪声主要是配套引风机的噪声，约 75dB，位于楼顶，根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：

1) 声环境影响预测模式

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

式中： $L_A(r)$ ——预测点 r 处 A 声级，dB(A)；

$L_A(r_0)$ —— r_0 处 A 声级，dB(A)；

A——倍频带衰减，dB(A)；

2) 声源在预测点产生的等效声级贡献值（ L_{eqg} ）计算公式

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

t_i ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

3) 预测点的预测等效声级（ L_{eq} ）计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中： L_{eqg} ——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb} ——预测点的背景值，dB(A)；

4) 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：

$$L_{div} = 20 \lg (r/r_0)$$

式中： r ——预测点与噪声源的距离（m）；

r_0 ——噪声合成点与噪声源的距离。

将受噪声影响最大的北面场界作为预测点，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见 29。

表 29 厂界噪声预测结果

关心点	噪声源	单台噪声值 (dB(A))	隔声(dB (A))	噪声源离预 测点距离 (m)	距离衰减 (dB(A))	单台贡 献值(dB (A))	总贡献 值(dB (A))
北厂界	引风机	75	10	25	28	37	40

经预测，经过隔声、减震及距离衰减后，对最近的北厂界的贡献值为 40 dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求，项目的噪声对周边声环境影响较小。

(4) 固体废物

建设项目产生生活垃圾、废包装材料由环卫部门统一清运；企业设置危废间，建筑面积 10m²，产生的危险废物临时储存于危废间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，企业危险废物处置承诺书见附件 4。建设项目固体废物利用处置方式评价见表，危险废物贮存场所贮存周期情况见表。

表 30 建设项目固体废物利用处置方式评价表

序号	固体废物名称	产生工序	属性	废物代码	产生量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	实验废液	实验室	危险废物	HW49 900-047-49	12.955	无害化	委托有危险废物处置资质单位上门收集、处置（承诺见附件 4）
2	废包装容器 (废试剂瓶、 废空桶等)	实验室		HW49 900-041-49	0.5	无害化	
3	废样品	实验室		HW49 900-047-49	0.4	无害化	
4	废活性炭	废气处理、研 发实验、纯水 制备		HW49 900-047-49	0.72	无害化	
5	废手套、试 纸、塑料管、 废硅胶、废布 草等	实验室		HW49 900-047-49	0.2	无害化	
6	废滤膜	纯水制备		HW49 900-047-49	0.01	无害化	
7	生活垃圾	员工生活	一般 固废	/	12	无害化	交环卫部门 处置
8	废包装材料	包装物	一般 固废	/	0.05	无害化	

1) 危险废物收集过程要求

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

2) 危险废物贮存场所

表 31 建设项目危险废物贮存场所贮存周期基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存周期
1	危险废物暂存间	实验废液	HW49	900-047-49	北侧	10m ²	危废专用桶、袋	三个月
2		废包装容器（废试剂瓶、废空桶等）		900-041-49				
3		废样品		900-047-49				
4		废活性炭		900-047-49				
5		废手套、试纸、塑料管、废硅胶、废布草等		900-047-49				
6		废滤膜		HW49 900-047-49				

危险废物贮存设施选址可行性。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的 6.1 节可知危险废物贮存设施的选址要求如下：①地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度的区域内。②设施底部必须高于地下水最高水位。③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。”在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。⑤应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。建设项目所在地地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度；建设项目位于江苏生命科技创新园 D6 栋 8 层，厂区选址高于地下水最高水位；建设项目位于江苏生命科技创新园，距离最近的居民区为项目北侧 510 米的大圩村，最近的水体为西侧 1200 米的九乡河，建设项目危险废物通过危废贮存设施（危废专用桶设有 50mm 直径的放气孔）密闭贮存后在危险废物贮存区存放，危险废物密闭贮存，仅从确保危废贮存安全的放气孔少量逸散，废气产生和排放量很小，且废气经过收集后通过管道排至顶楼活性炭吸附装置处理达标后排放，不会对大气环境和敏感目标产生不利影响，建设项目位于 8 层，发生泄露时不会对地表水环境和地下水环境产生不利影响；建设项目不

在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；建设项目易燃易爆物品存放在实验室的安全柜中，其他原辅材料存放在仓库内，因此项目危险废物贮存设施在危险品仓库的防护区域以外。因此，本项目危险废物贮存设施的选址合理。

项目拟设危废间(分为液体废弃物暂存间和固体废弃物暂存间)建筑面积共计 10m²，满足防风、防雨、防晒要求，满足贮存容量要求，危废贮存间的设置应按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制》(GB18597)及其修改单的要求设置，要求做到以下几点：

①危险废物应按种类、性质等分类收集、分区存放，项目危废贮存间内设液态危废贮存区、固态危废贮存区；

②实验废液应置于危废专用桶内，并置于托盘内，固态危废应置于危废专用袋内，满足防扬散、防渗漏、防流失要求。对照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，本项目危废临时贮存库房的建设符合标准中 6.2 条(危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则)、6.3.1 条(基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料(渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s)、6.3.9 条(危险废物堆要防风、防雨、防晒)、6.3.11 条(不相容的危险废物不能堆放在一起)等规定。暂存点及暂存容器按《环境保护图形标志(GB15562—1995)》的规定设置警示标志；

③应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤危废间应进行防渗处理等。

⑥建设项目危险废物交有资质单位处置，应落实好危废转移联单制度。

根据危废内危废产生量及贮存期限，危险废物暂存间 3 个月最大贮存量约 3.7t，项目危险废物暂存间占地面积 10m²，最大贮存量分别约为 7t，可满足贮存要求。

项目危险废物贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生明显的不利影响。

综上，建设项目采取上述措施后，危险废物贮存场所设置合理，对外环境影响小。

3) 危险废物运输

本项目危险废物产生于实验室内，危险废物产生后置于专门的容器，产生后及时运至危废贮存间，危险废物产生及贮存过程中不在实验室外部运输，不会因散落、泄漏所引起环境影响。危险废物由有资质单位上门收集处理，由其负责厂外运输环境影响，危

险废物运输应满足相关规定及要求。

4) 危险废物委托处置

公司将严格按照危险废物管理相关法律法规进行危险废物处置，承诺委托有危险废物处置资质单位上门收集、处置危险废物，并保证处置单位处置范围、期限等满足危险废物处置要求，承诺书详见附件 4。

建设项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。

环境风险

(1) 风险识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目主要涉及的风险物质为甲醇、乙腈、异辛醇等。“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元”定为重大危险源，风险导则重点关注的危险物质及临界量，危险化学品名称及其临界量具体见表 32。

表 32 危险化学品名称及其临界量

序号	危险化学品名称	临界量 t	本项目最大存储量 t	q/Q 值
1	甲醇	10	0.2	0.02
2	乙腈	10	0.2	0.02
3	异辛醇	10	0.0005	0.00005
4	异丙醇	4	0.004	0.001
5	氨水	10	0.005	0.0005
6	苯胺	5	0.0005	0.0001
7	乙酸	10	0.002	0.0002
8	正己烷	10	0.018	0.0018
9	二甲胺	5	0.0001	0.00002
10	甲酸	10	0.0005	0.00005
11	乙胺	10	0.0005	0.00005
12	N,N-二甲基甲酰胺	5	0.006	0.02
合计				0.04377

由表 32 可知，企业主要进行医药研发，药剂使用量较少，风险物质 q/Q 值合计为 0.04377，小于 1，因此，项目不构成重大危险源。项目环境风险潜势为 I 级，评价工作

等级为简单分析。

(2) 环境敏感目标概况

周围的环境保护目标见表 6，项目最近敏感区为南侧约 480m 的南京大学仙林校区，项目距最近的生态红线保护区域为北侧 160m 的栖霞山国家森林公园。

(3) 环境风险识别

本项目危险物质主要包括各类试剂和实验废液，其产生的环境风险主要为上述危险物质的泄漏。

1) 各类试剂泄漏：在运输过程中，因意外事故造成泄漏，挥发进入大气或流入水体，将会对周围大气和水环境产生不利影响。在使用、贮存过程中如操作失误，致物料直接流失至预处理设施，将影响废水预处理效果。

2) 实验废液泄漏：本项目危险废物中包括实验废液（含初次清洗废水）、废弃包装、废活性炭等。本项目危险废物的主要风险为实验废液泄漏对周围环境产生不利影响。建设项目产生的实验废液储存在废液桶中，并置于托盘内，当事故时，液体可迅速流入托盘进行收集，不会对土壤、地下水造成影响，处置不当可能对周围大气环境产生不利影响。

(4) 项目风险分析

①因操作失误，实验设备故障引起实验物料等流失至园区预处理设施，影响废水预处理效果，由于所采用废水处理工艺简单，管理不复杂，通常出现瘫痪性故障的概率极低。

②有毒有害原料在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生较大的影响。危险品采用特制容器密闭包装，专用车辆运输，按要求进行贮存，包装破损的可能性较小，危险品全过程记录出入库情况，指定专人保管。

③有毒有害原料接触引发人身损伤。此类物质应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用有毒物质时应穿工作服、戴口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。

④危险废物泄漏。危险废物中包括实验废液（包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等），废包装容器（废试剂瓶、废空桶等），废样品，废活性炭，废滤膜，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等。本项目危险废物的主要风险影响为实验废液泄漏。建设项目产生的实验废液储存在废液桶中，并置于托盘内，当事故时，液体可迅速流入托盘

进行收集，不会对土壤、地下水造成影响。且实验废液产生量小，因贮存场所通风条件良好，且泄漏量不大，因此，对企业和周围大气环境影响不大。

⑤园区污水处理装置一旦出现故障，所有企业废水需排至事故池，禁止直排。

(5) 风险防范及应急措施

原料储存风险防范措施：

项目原料储存需符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），严格实施危险化学品的储存和使用管理。建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育。

危废暂存场所风险防范措施：

①危险废物暂存场所严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施；

②危险废物暂存场所需设置便于危险废物泄漏的收集处理的设施；

③在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应；

④设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作，建立危险废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。对本项目从事危险废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

(6) 分析结论

采取上述风险防范措施后，项目的环境风险控制在可接受水平。建设项目环境风险简单分析内容见表33。

表 33 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	医药研发项目
--------	--------

建设地点	南京市栖霞区纬地路9号D6栋809、810、811室			
地理坐标	经度	118.965476	纬度	32.139649
主要危险物质及分布	危险物质主要是实验室内的有毒有害试剂和危险废物			
环境影响途径及危害后果	有毒有害试剂和废液泄漏，对周围大气环境和水环境的影响			
风险防范措施要求	防范措施主要有： 1、采用专用容器密闭包装，专用车辆运输 2、加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程 3、危险废物暂存场所严格按照国家标准和规范进行设置 4、配置合格的防毒器材、消防器材			

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

建设项目主要从事制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究等医药研发，本项目 $Q < 1$ 时，根据风险导则附录C，其风险潜势为I，可开展简单分析。采取风险防范措施后，其风险可控，处于可接受水平。

环境管理

（1）建立公司危险化学品定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地相关行政主管部门。

（2）努力改进并达到实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。

（3）安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常状态并达标排放。

（4）建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置，并落实危险废物转移联单制度，做好危险废物的转移记录。

（5）建立一套完好的操作记录，建立实验设备运行台账，做到一机一档，发现问题及时解决。

（6）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南》HJ819-2017及相关管理要求，本项目制定了污染源监测计划，详见表33。

表 33 本项目污染源监测计划

污染物名称	监测点位	监测项目	监测频率	采样分析方法
-------	------	------	------	--------

废气	P1	VOCs、甲苯	1次/年	按相关规范要求执行
废水	废水装置排口	pH、COD、氨氮、总磷、SS	1次/年	按相关规范要求执行

上述污染源监测须委托有资质单位按规范要求进行监测，如达标状况较差，应采取相应措施，尽快处理达标，同时在应急处置过程中应适当增加监测频次。

排污口设置

排污口应根据苏环控[97]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范化设置，楼顶设置的1个废气排放口需按要求设置环保标志牌，明确所排废气污染物的种类，设置便于采样的采样孔；危险废物暂存间应设置标志牌；项目废水依园区预处理装置处理，接入园区污水管网，排口处设置标志，明确水污染物的种类，废水装置应留有便于采样的位置。

建设项目“三同时”验收一览表

建设项目总投资1000万元，环保投资33万元，占总投资的3.3%，具体环保投资情况见表34。

表34 建设项目“三同时”验收一览表

污染源	环保设施名称	环保投资（万元）	效果
废气	实验废气经通风橱收集后与收集至通风橱管道的危险废物贮存区废气一起经园区废气管道引至楼顶，通过拟建活性炭吸附装置处理达标后通过1个排气筒高空排放。	20	使建设项目所排废水、废气、固废和噪声均能达标
废水	生活污水依托园区化粪池预处理，实验废水、洗衣废水依托园区废水处理装置预处理。	依托园区现有设施	
固废	设10m ² 危废贮存间，分类、分区收集储存危险废物，定期交有危险废物处置资质单位上门收集、处置。	10	
噪声	减振底座、隔声措施	1	
风险应急	培训、管理、监测	2	
合计	/	33	总投资3.3%

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	实验废气、危废间废气	有机废气	实验废气经过通风橱收集后与收集至通风橱管道的危险废物贮存区废气一起通过园区内置废气管道引至楼顶活性炭吸附装置处理达标排放,排口设于楼顶。	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2特别排放限值
水污 染物	生活污水、实验废水、洗衣废水	COD、SS、氨氮、总磷、总氮	生活依托园区化粪池处理,实验废水、洗衣废水依托园区废水预处理装置处理	依托园区预处理达仙林污水处理厂二期接管标准后经仙林污水处理厂处理达标后排放。
电离电 磁辐射	无	-	-	-
固体 废物	办公室、实验室	废滤膜、实验废液(包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等),废包装容器(废试剂瓶、废空桶等),废样品,废活性炭,废手套、试纸、注射器、移液器枪头等	委托有危险废物处置资质单位上门收集、处置	无害化
		生活垃圾、废包装材料	环卫部门统一收集处置	
噪声	采用低噪声设备,通过隔声、减震,可达标排放。			
其它	/			
<p>生态保护措施及预期效果:</p> <p>建设项目为租用江苏生命科技创新园的现有房屋进行建设,不新增占地,无土建施工,对生态影响小。</p>				

结论和要求

一、结论

南京福美瑞信科技有限公司租用南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号D6栋809、810、811室作为医药研发及办公用房。该公司于2019年申报了“南京福美瑞信科技有限公司医药研发项目”，目前该项目已经在栖霞区发改局备案（备案号：栖发改备[2019]55号，项目代码：2019-320113-73-03-527805）。

该公司主要从事制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究，包括片剂、胶囊剂以及外用凝胶剂等剂型，所研究的药物主要包括心血管系统以及消化系统类药物，总研发量约为400kg/a。本项目研发的样品不外售，研发均只涉及小试，不涉及中试及生产，研发过程无中间体及副产品产生。本项目属于医药研发项目，不属于涉重和化工项目。

（1）选址与规划相容

项目主要进行制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究，建设项目选址符合南京市栖霞区的产业规划，其位于江苏生命科学园内，属于仙林新市区白象片区，该区为仙林新市区中重点发展地区，集中安排国际高教园区、科研机构和产业用地，以“产、学、研”同步发展为特色，力争形成南京市重要的高新技术产业园。因此，建设项目选址符合相关城市建设发展规划。

（2）符合国家产业政策

建设项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类：十三、医药 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类：十一、医药 1、拥有自主知识产权的新药开发和生产。因此建设项目符合相关国家和地方产业政策。

（3）环境质量现状较好

建设项目所在地周围大气环境质量： SO_2 能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，； PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 NO_2 年均浓度超标，主要是由于汽车尾气和工地扬尘所致。

建设项目所在地周围不存在对环境产生较大影响的噪声源，其声环境质量能达到2类区划功能的要求。

长江总体水质稳定，除了总磷为III类标准外，其它各类指标基本能达到规划功能的

地表水Ⅱ类标准。

(4) 污染防治措施切实可行，能确保达标排放，对环境影响较小。

1) 水环境

实验废水、洗衣废水经过园区废水处理装置预处理，生活污水经过园区化粪池预处理，预处理后的废水达到仙林污水厂二期接管标准后，接入园区南侧市政污水主管井，最终排入仙林污水处理厂处理，处理达标后的尾水排入九乡河，最终排入长江。建设项目废水排放量较小且为达标排放，对地表水的环境影响很小。

2) 大气环境

本项目废气主要为实验过程产生的挥发性有机废气。涉及挥发性化学品的研发实验均在通风柜内进行，实验产生的废气经通风橱收集后，与收集至通风橱管道的危险废物贮存区废气一起由大楼内置废气管道引至大楼楼顶进入活性炭处理装置进行处理，处理达标后通过排气筒高空排放，项目设1个废气排口，位于D6栋顶楼，排气筒排放高度约50m。项目废气经活性炭吸附装置吸附处理后能够达到相应排放标准，项目废气经活性炭吸附装置处理可行。建设项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变周围大气的环境功能。

3) 噪声

该项目噪声主要是配套引风机的噪声，声级单台约为75dB，经过隔声、距离衰减及减震等措施后，对声环境影响很小。

4) 固体废物

建设项目固体废物主要为生活垃圾，实验废液（包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等），废包装容器（废试剂瓶、废空桶等），废样品，废活性炭，废滤膜，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等。

生活垃圾及一般固废由环卫部门统一清运；废滤膜、实验废液（包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等）、废包装容器（废试剂瓶、废空桶等）、废样品、废活性炭、废手套、试纸、注射器、移液器枪头等为危险废物，企业设置危废贮存间，建筑面积共计10m²，产生的危险废物临时储存于危废间内，委托有危险废物处置资质单位上门收集、处置。危废贮存间的设置应按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制》（GB18597）及其修改单的要求设置。项目最终的固体废弃物均得到了妥善处置，外排量为零，对环境影响较小。

(5) 环保投资合理，区域排放总量控制

建设项目总投资 1000 万元，环保投资 33 万元，占总投资金额的 3.3%，专门用于“三废”治理。在这些环保设施运转正常的情况下，能确保建设项目的污染物达标排放，使得建设项目对环境的影响程度可控制在国家认可和当地百姓可接受的范围内。

项目废水依托园区预处理设施达到仙林污水厂二期接管标准要求后，通过市政污水管网进入仙林污水处理厂。：园区预处理设施出水考核指标为：废水排放 1582t/a，COD 0.4781t/a，SS 0.2713t/a，氨氮 0.0244t/a，总磷 0.0019t/a，总氮 0.0252t/a，LAS0.0014t/a。项目水污染物经污水处理厂处理后出水总量控制指标为：废水排放量 1582t/a，COD 0.0791t/a，SS 0.0158t/a，氨氮 0.0079t/a，总磷 0.0008t/a，总氮 0.0237t/a、LAS0.0008t/a。

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119 号），县级以上地方人民政府统筹负责本行政区域内挥发性有机物污染防治工作，严格控制和有计划削减挥发性有机物排放总量。因此，大气污染物总量控制指标为：废气排放量为 1080 万 m³/a，VOCs 0.0535t/a，项目 VOCs 暂不属于省、市年度总量控制指标，因此，近期作为区域自控指标，待相关管理办法出台后按要求执行。

固体废物：建设项目固体废物为生活垃圾、废包装材料，实验废液（包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等），废包装容器（废试剂瓶、废空桶等），废样品，废活性炭，废滤膜，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等，均妥善处置，零排放。

(6) 总结论

建设项目与南京栖霞区的产业规划相符，用地符合国家土地政策，项目选址合理；研发内容符合国家当前产业政策；项目总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目选址周围的环境现状质量尚好，若各项环保设施能如期建成并运转正常，则项目对周围的环境影响较小。

综上所述，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。

二、要求

(1) 建设项目应确保“三同时”环保措施落实到位，保证环保治理设施正常运转，确保废气、声及固废达标排放，使建设项目对外环境的影响降到最低程度。

(2) 公司应加强研发设备及配套处理装置的日常管理、维护工作，杜绝事故排放的发生，杜绝因设备的非正常运行而出现的噪声超标现象。

(3) 建设项目的运营应根据园区废水预处理设施运行情况及时进行调整。企业应

及时与园区协调沟通，安排实验进度及废水排放，确保废水达标排放，超过园区废水预处理设施运行能力时，应立即停止实验。

附图和附件

- 附图1 建设项目所在地理位置示意图
- 附图2 建设项目周边环境概况示意图
- 附图3 建设项目总平面布置图
- 附图4 建设项目所在区域用地规划图
- 附图5 本项目与南京市生态红线区域位置关系图
- 附图6 园区污水接管管网图

- 附件1 建设项目备案证及登记信息单
- 附件2 园区污水接管证明
- 附件3 工程竣工验收证明书
- 附件4 危险废物处置承诺书
- 附件5 建设项目全本公示截图
- 附件6 建设项目环境影响评价委托书

审批意见:

经办人:

公 章
年 月 日